

2025

ELEMENT

ABOUTMENTS

Válido desde el **01 DE JULIO, 2025**  
hasta la publicación de un nuevo catálogo.

#### **Aviso legal**

Las imágenes de los productos no representan el tamaño real de los aditamentos.  
Por favor contacte con el representante de ventas para obtener información sobre los los productos.

#### **Atención telefónica**

**(+34) 679 86 7798**

[pedidos@element-dental.com](mailto:pedidos@element-dental.com)

#### **Manejo de productos**

Para el manejo, indicaciones y contraindicaciones, visite nuestro sitio web donde encontrará todas nuestras instrucciones de uso.

[www.element-dental.com](http://www.element-dental.com)



# ÍNDICE

## 4 CERTIFICACIONES

## 5 LIBRERÍAS DIGITALES FUNCIONALIDADES

## 7 TRANSEPITELIALES



8 MULTI UNIT 4.8



11 SRA 4.6



12 UNIT 4.1



13 MULTI IM 4.1

## 17 SCANBODIES

## 22 HEXÁGONO EXTERNO



23 UNIVERSAL

## 27 BTI®



28 INTERNO



32 MULTI IM 4.1



34 UNIT 4.1

## 36 STRAUMANN®



37 TISSUE LEVEL®



39 BLX®



41 BONE LEVEL®



43 SYNOCTA®

## 45 NEODENT®



46 GM®

## 50 PHIBO®



51 AUREA EVO®

## 53 MIS®



54 SEVEN®

## 56 KLOCKNER®



57 VEGA®

## 59 ZIMVIE®



60 SCREW-VENT®



62 3I CERTAIN®

## 64 ELEMENT



65 BH

67 TOOLS



69 ZYGOMA



# ELEMENT

## Innovación y Experiencia al Servicio de la Odontología



En Element Abutments, no somos solo una empresa de aditamentos dentales: somos un proyecto que nace y se lidera desde la **visión de un dentista**, con más de 20 años de experiencia en clínica, laboratorio y centro de fresado.

Hemos construido nuestra empresa sobre la experiencia real del día a día en la odontología, comprendiendo las necesidades de los profesionales y los desafíos que enfrentan.

## Precisión, Funcionalidad e Innovación

Estos son los Pilares sobre los que desarrollamos soluciones odontológicas avanzadas y accesibles, pensadas para facilitar el trabajo clínico y optimizar los resultados en el tratamiento protésico.

**De la práctica clínica, al diseño basado en experiencia real.**

### Aditamentos ELEMENT

La alta precisión en el mecanizado de nuestros aditamentos favorece un ajuste pasivo consistente. Esta exactitud dimensional es fundamental para preservar la integridad biomecánica del tratamiento y optimizar la predictibilidad clínica a largo plazo.

## Innovación en Diseño: Perfiles Estrechos

Una de nuestras características más significativas es la incorporación de perfiles más estrechos en las conexiones protésicas.

Este diseño avanzado contribuye a una conformación gingival más natural, al reducir el espacio alrededor de la conexión implante-aditamento.

Gracias a esto se logra una integración más biológica y estética con los tejidos blandos circundantes, lo que se traduce en resultados funcionales y una apariencia estética más duradera en el tiempo.



## Nuestra misión es clara:

En Element, nos dedicamos al desarrollo de soluciones protésicas que integran precisión técnica y adaptabilidad clínica, alineadas con las demandas reales de la odontología contemporánea.

Nuestro compromiso es proporcionar productos que se ajusten a los estándares exigentes del mercado y respondan a las necesidades específicas de cada profesional dental, facilitando procedimientos y resultados más óptimos.

**/// La innovación cobra sentido cuando se traduce en mejoras tangibles para la práctica diaria. ///**


Dr. Iñaki Mayo.

Enfocamos nuestros esfuerzos en diseñar y ofrecer componentes que no solo incorporen avances tecnológicos, sino que también aporten valor real en el entorno clínico, contribuyendo al éxito de cada tratamiento y a la satisfacción del paciente.

## CERTIFICACIONES



**ISO 13485:2016/A11:2021**

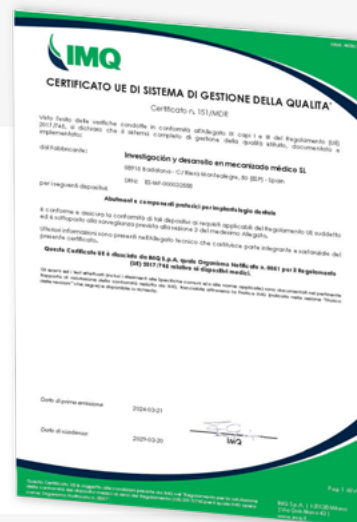

**Certificado CE MDR**

CE 0051

- ANÁLOGO
- INTERFASES
- PILAR LOCATOR
- PILAR PROVISIONAL
- PILAR DE CICATRIZACIÓN
- REGISTRO OCLUSAL
- SCANBODY
- TRANSEPITELIAL
- TRANSFER
- TORNILLO

## LIBRERÍAS DIGITALES



Escanee el siguiente  
código QR



Encuentra toda la información  
en la sección **Cad-Cam**  
de nuestro sitio web  
[www.element-dental.com/librerias](http://www.element-dental.com/librerias)




## TABLA DE FUNCIONALIDADES


|                         | Hex. Ext. Universal Ø4.1 | AVINENT® EC Ø4.1/5.1 | BTI® EXTERNA Ø4.1 | ECKERMAN® | NOBEL® BRANEMARK® | PHIBO® TSH® S3/S4 | MIS® SEVEN® Ø3.75/4.2 | ZIMVIE® Screw-Vent® | BIOHORIZONS® | Element BH |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| Hex.Ext. Universal Ø4.1 | ●                        | ●                    | ●                 | ●         | ●                 | ●                 |                       |                     |              |            |
| AVINENT® EC Ø4.1/5.1    | ●                        | ●                    | ●                 | ●         | ●                 | ●                 |                       |                     |              |            |
| BTI® EXTERNA Ø4.1       | ●                        | ●                    | ●                 | ●         | ●                 | ●                 |                       |                     |              |            |
| ECKERMAN®               | ●                        | ●                    | ●                 | ●         | ●                 | ●                 |                       |                     |              |            |
| NOBEL® BRANEMARK®       | ●                        | ●                    | ●                 | ●         | ●                 | ●                 |                       |                     |              |            |
| PHIBO® TSH® S3/S4       | ●                        | ●                    | ●                 | ●         | ●                 | ●                 |                       |                     |              |            |
| MIS® SEVEN® Ø3.75/4.2   |                          |                      |                   |           |                   |                   | ●                     | ●                   | ●            | ●          |
| ZIMVIE® Screw-Vent®     |                          |                      |                   |           |                   |                   | ●                     | ●                   | ●            | ●          |
| BIOHORIZONS®            |                          |                      |                   |           |                   |                   | ●                     | ●                   | ●            | ●          |
| Element BH              |                          |                      |                   |           |                   |                   | ●                     | ●                   | ●            | ●          |

PLATAFORMAS  
UNIVERSALES


MULTI  
IM  
4.1

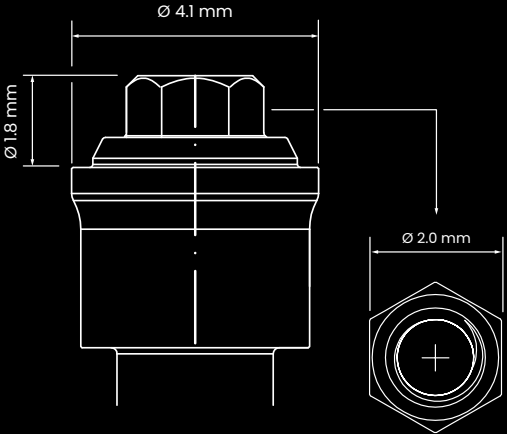

MULTI  
UNIT  
4.8

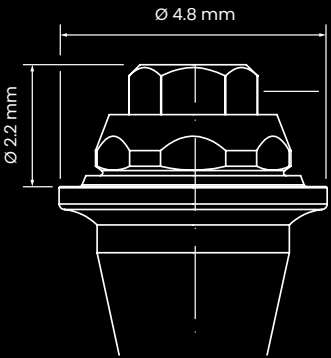

SRA  
4.6

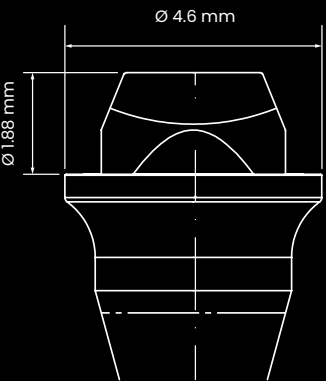






# TRANSEPTILIALES

# TRANSEPITELIAL



## MULTI UNIT 4.8

### TRANSEP. HEX. EXT. TIPO BRANEMARK MULTI UNIT 4.8

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | NB02.14.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | NB02.14.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | NB02.14.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | NB02.14.240 |    |

#### PLATTFORM SWITCHING (PS)

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | NB02.15.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | NB02.15.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | NB02.15.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | NB02.15.240 |    |

### TRANSEPITELIAL BTI® INTERNO MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NP Ø 3.5    | RP Ø 4.10   | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 1.0 MM   | BT02.14.110 | BT02.14.210 |    |
|                                                                                     | 2.0 MM   | BT02.14.120 | BT02.14.220 |    |
|                                                                                     | 3.0 MM   | BT02.14.130 | BT02.14.230 |    |
|                                                                                     | 4.0 MM   | BT02.14.140 | BT02.14.240 |    |

### TRANSEP. STRAUMANN BONE LEVEL® MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NC Ø3.3     | RC Ø4.1     | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 1.5 MM   | ST02.14.115 | ST02.14.215 |    |
|                                                                                     | 2.5 MM   | ST02.14.125 | ST02.14.225 |    |
|                                                                                     | 3.5 MM   | ST02.14.135 | ST02.14.235 |    |
|                                                                                     | 4.5 MM   | ST02.14.145 | ST02.14.245 |    |

### TRANSEPITELIAL STRAUMANN® BLX® MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NB | RB/WB       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|
|  | 1.5 MM   |    | ST03.14.215 |
|                                                                                     | 2.5 MM   |    | ST03.14.225 |
|                                                                                     | 3.5 MM   |    | ST03.14.235 |
|                                                                                     | 4.5 MM   |    | ST03.14.245 |



## MULTI UNIT 4.8

### TRANSEPITELIAL NEODENT® GM® MULTI UNIT 4.8

0°



| LONGITUD | NP | GM          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.5 MM   |    | NE02.14.215 |    |
| 2.5 MM   |    | NE02.14.225 |    |
| 3.5 MM   |    | NE02.14.235 |    |
| 4.5 MM   |    | NE02.14.245 |    |

17°



| LONGITUD | NP | GM          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.5 MM   |    | NE02.14.615 |    |
| 2.5 MM   |    | NE02.14.625 |    |
| 3.5 MM   |    | NE02.14.635 |    |

30°



| LONGITUD | NP | GM          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.5 MM   |    | NE02.14.815 |    |
| 2.5 MM   |    | NE02.14.825 |    |
| 3.5 MM   |    | NE02.14.835 |    |

### TRANSEPITELIAL PHIBO® AUREA EVO® MULTI UNIT 4.8



| LONGITUD | NP Ø 3.5    | RP Ø 4.3/ Ø 4.8 | WP Ø 5.5    |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 0.5 MM   | PH02.14.105 | PH02.14.205     |             |
| 1.0 MM   | PH02.14.110 | PH02.14.210     |             |
| 2.0 MM   | PH02.14.120 | PH02.14.220     | PH02.14.320 |
| 3.0 MM   | PH02.14.130 | PH02.14.230     |             |
| 4.0 MM   | PH02.14.140 | PH02.14.240     |             |

### TRANSEPITELIAL MIS® SEVEN® MULTI UNIT 4.8



| LONGITUD | NP Ø 3.3    | RP Ø 3.75/Ø 4.2 | WP Ø 5.0    |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 1.0 MM   | MI02.14.110 | MI02.14.210     | MI02.14.310 |
| 2.0 MM   | MI02.14.120 | MI02.14.220     | MI02.14.320 |
| 3.0 MM   | MI02.14.130 | MI02.14.230     | MI02.14.330 |
| 4.0 MM   | MI02.14.140 | MI02.14.240     | MI02.14.340 |

## MULTI UNIT 4.8

### TRANSEPITELIAL KLOCKNER® VEGA® MULTI UNIT 4.8

|                                                                                   | LONGITUD | NV          | RV          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 1.5 MM   | KL04.14.115 | KL04.14.215 |    |
|                                                                                   | 2.5 MM   | KL04.14.125 | KL04.14.225 |    |
|                                                                                   | 3.5 MM   | KL04.14.135 | KL04.14.235 |    |
|                                                                                   | 4.5 MM   | KL04.14.145 | KL04.14.245 |    |

### TRANSEPITELIAL ZIMVIE® 3I CERTAIN® MULTI UNIT 4.8

|                                                                                   | LONGITUD | NP Ø3.5     | RP Ø 4.0    | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 0.5 MM   | BI02.14.105 | BI02.14.205 |    |
|                                                                                   | 1.5 MM   | BI02.14.110 | BI02.14.210 |    |
|                                                                                   | 2.5 MM   | BI02.14.120 | BI02.14.220 |    |
|                                                                                   | 3.5 MM   | BI02.14.130 | BI02.14.230 |    |
|                                                                                   | 4.5 MM   | BI02.14.140 | BI02.14.240 |    |


### TRANSEPITELIAL ZIMVIE® SCREW-VENT® MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP Ø 3.75/Ø 4.2 | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | MI02.14.210     |    |
|                                                                                     | 2.0 MM   |    | MI02.14.220     |    |
|                                                                                     | 3.0 MM   |    | MI02.14.230     |    |
|                                                                                     | 4.0 MM   |    | MI02.14.240     |    |

### TRANSEPITELIAL ELEMENT ZYGOMA EXT. MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | ID00.14.210 |    |
|                                                                                     | 2.0 MM   |    | ID00.14.220 |    |
|                                                                                     | 3.0 MM   |    | ID00.14.230 |    |
|                                                                                     | 4.0 MM   |    | ID00.14.240 |    |

# TRANSEPITELIAL



SRA 4.6

## TRANSEPITELIAL ELEMENT ZYGOMA SRA 4.6



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.0 MM   |    | ST07.22.210 |    |

## TRANSEPITELIAL BONE LEVEL SRA 4.6




| LONGITUD | NP | RC Ø 4.1    | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.5 MM   |    | ST07.35.215 |    |
| 2.5 MM   |    | ST07.35.225 |    |
| 3.5 MM   |    | ST07.35.235 |    |
| 4.5 MM   |    | ST07.35.245 |    |

## ANÁLOGO SRA 4.6



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
|          |    | ST07.05.200 |    |

# TRANSEPITELIAL



# UNIT 4.1

## TRANSEPITELIAL BTI® INTERNO (2 PIEZAS) UNIT 4.1



| LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.5 MM   |    | BT02.12.215 |    |
| 2.0 MM   |    | BT02.12.220 |    |
| 3.0 MM   |    | BT02.12.240 |    |

### PLATTFORM SWITCHING (PS)



| LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.5 MM   |    | BT02.13.215 |    |
| 2.0 MM   |    | BT02.13.220 |    |

# TRANSEPITELIAL MULTI IM 4.1

## TRANSEPITELIAL HEX. EXT. TIPO BRANEMARK (2 PIEZAS)

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | BT03.16.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | BT03.16.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | BT03.16.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | BT03.16.240 |    |

### PLATFORM SWITCHING (PS)

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 2.0 MM   |    | BT03.17.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | BT03.17.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | BT03.17.240 |    |

## TRANSEPITELIAL INTERNO MULTI IM 4.1

|                                                                                     | LONGITUD | NP Ø 3.5    | RP Ø 4.1    | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 0.5 MM   | BT02.22.105 | BT02.16.205 |    |
|                                                                                     | 1.0 MM   | BT02.22.110 | BT02.16.210 |    |
|                                                                                     | 2.0 MM   | BT02.22.120 | BT02.16.220 |    |
|                                                                                     | 3.0 MM   | BT02.22.130 | BT02.16.230 |    |
|                                                                                     | 4.0 MM   | BT02.22.140 | BT02.16.240 |    |

### PLATFORM SWITCHING (DOS PIEZAS)

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 2.0 MM   |    | BT02.17.220 |    |
|                                                                                     | 3.0 MM   |    | BT02.17.230 |    |
|                                                                                     | 4.0 MM   |    | BT02.17.240 |    |



## MULTI IM 4.1


### TRANSEPITELIAL NEODENT® GM® MULTI IM 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP | GM          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 0.5 MM   |    | NE02.16.205 |    |
|                                                                                   | 1.0 MM   |    | NE02.16.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | NE02.16.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | NE02.16.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | NE02.16.240 |    |
|                                                                                   | 6.0 MM   |    | NE02.16.260 |    |

### TRANSEPITELIAL ELEMENT ZYGOMA EXTERNO MULTI IM 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | ID00.12.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | ID00.12.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | ID00.12.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | ID00.12.240 |    |

# MULTI IM



4.1

## TRANSFER MULTI IM 4.1



LONGITUD

NP

RP

WP

BT01.06.001

## ANÁLOGO MULTI IM 4.1



LONGITUD

NP

RP

WP

BT01.05.001

## DIGITAL



LONGITUD

NP

RP

WP

ID00.05.002

## PILAR DE CICATRIZACIÓN MULTI IM 4.1

### STANDARD



RP

BT01.18.001

### SLIM



RP

BT01.18.002

## REGISTRO OCLUSAL MULTI IM 4.1



LONGITUD

NP

RP

WP

6.0 MM

BT01.18.060

9.0 MM

BT01.18.090

## SCANBODY TITANIO MULTI IM 4.1



LONGITUD

NP

RP

WP

ID00.10.015

## MULTI IM 4.1

### PILAR PROVISIONAL MULTI IM 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | BT01.07.200 |    |

### INTERFASE MULTI IM 4.1 (2 PIEZAS)

#### RECTA

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 0.5 MM   |    | BT01.08.005 |    |

#### CUSTOM ESTÉTICA

|                                                                                    | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 0.5 MM   |    | BT01.08.405 |    |

#### DIMÁMICA

#### CUSTOM ESTÉTICA

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 0.5 MM   |    | BT01.08.805 |    |

### TORNILLO MULTI IM 4.1 | UNIT 4.1 | MULTI UNIT 4.8

#### RECTO

NP / RP / WP



BT01.02.002

#### DINÁMICO

NP / RP / WP



BT01.02.001

#### M.U.A.

#### RECTO

NP / RP / WP



ID00.02.004


#### DINÁMICO

NP / RP / WP



ID00.02.005



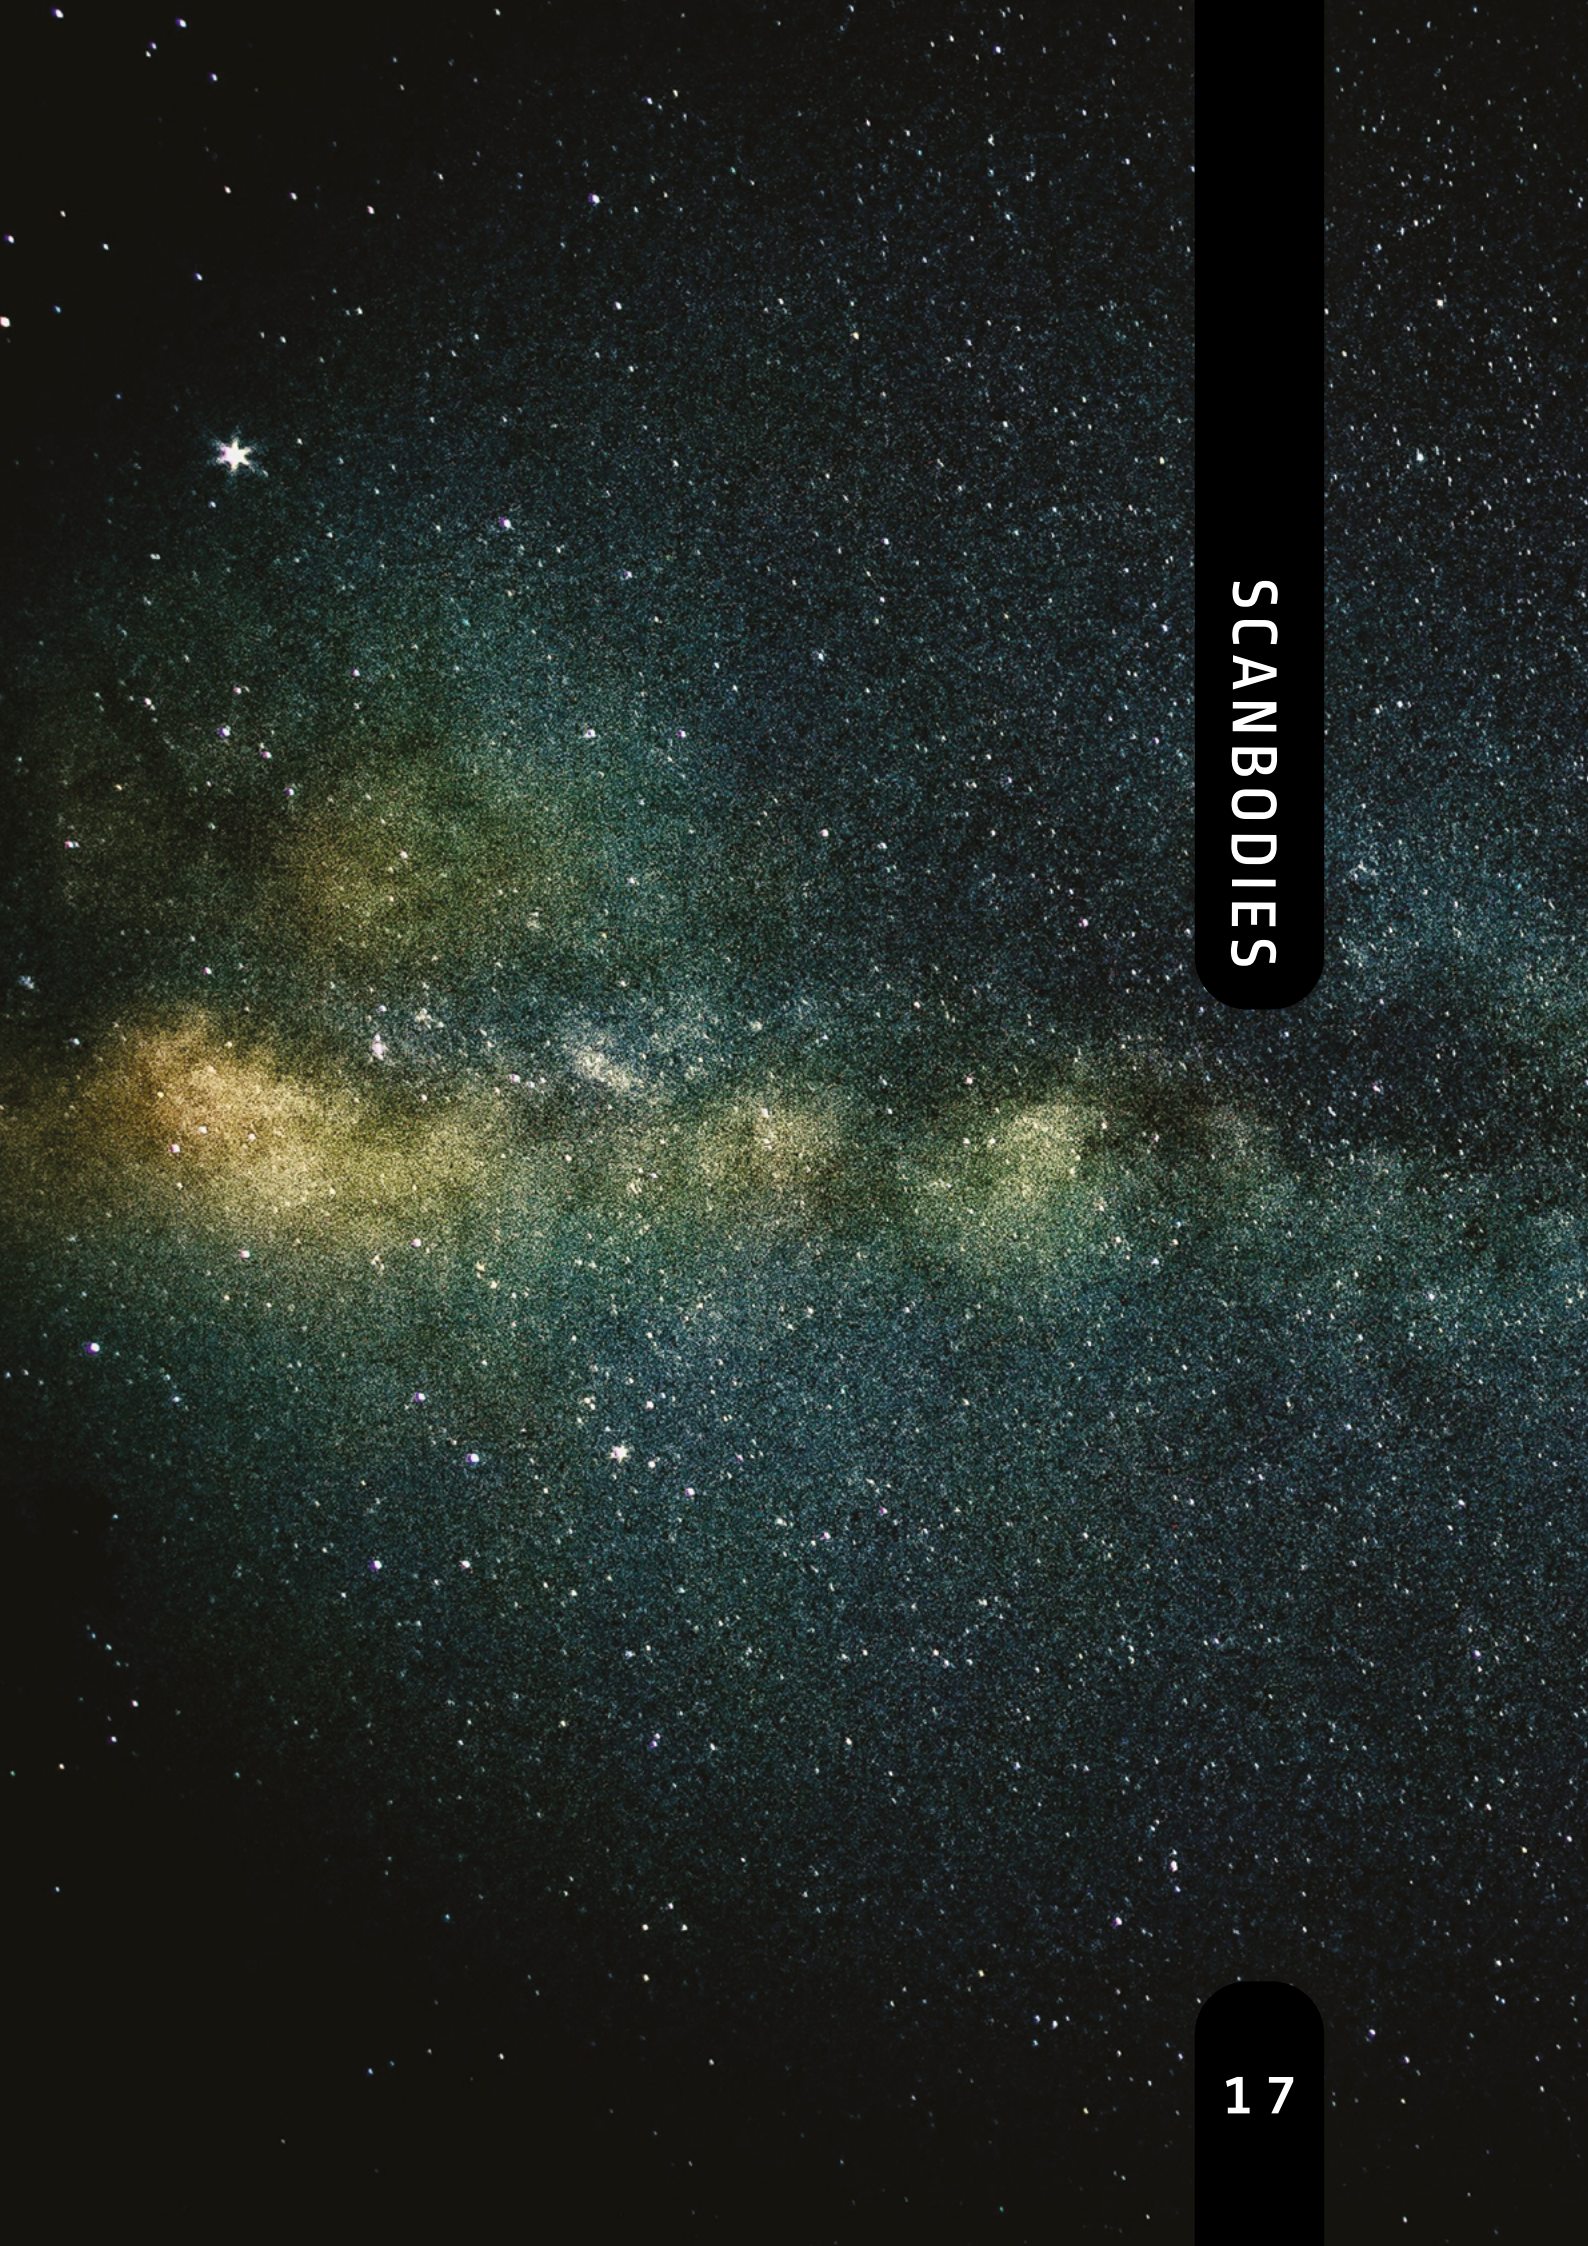

## SCANBODIES



## SCANBODY

### SCANBODY TITANIO MULTI IM 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | ID00.10.015 |    |

### SCANBODY MULTI UNIT 4.8

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | ID00.10.016 |    |

### SCANBODY TITANIO UNIT 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | ID00.10.021 |    |

### SCANBODY HEXÁGONO EXTERNO

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | ID00.10.017 |    |

### SCANBODY TITANIO BTI® INTERNO

|                                                                                     | LONGITUD | NP          | RP | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|----|
|  |          | BT02.10.100 |    |    |

### SCANBODY TITANIO MIS® SEVEN®

|                                                                                     | LONGITUD | NP          | RP          | WP          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|  |          | ID00.10.019 | ID00.10.018 | MI02.10.300 |

### SCANBODY PEEK PHIBO® AUREA EVO®

|                                                                                     | LONGITUD | NP          | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  |          | PH02.10.100 | PH02.10.200 |    |

# SCANBODY

## SCANBODY STRAUMANN®



### SCANBODY BONE LEVEL®

|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| LONGITUD | NP | RP | WP |
|----------|----|----|----|



### SCANBODY TITANIO TISSUE LEVEL®

|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| LONGITUD | NP | RP | WP |
|----------|----|----|----|

ST01.10.200



### SCANBODY TITANIO BLX®

|          |    |         |
|----------|----|---------|
| LONGITUD | NB | RB / WB |
|----------|----|---------|

ID00.10.026



### SCANBODY TITANIO SYNOCTA®

|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| LONGITUD | NP | RP | WP |
|----------|----|----|----|

ID00.10.027

## SCANBODY TITANIO NEODENT® GM®



|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| LONGITUD | NP | GM | WP |
|----------|----|----|----|

ID00.10.020

## SCANBODY TITANIO ZIMVIE® SCREW-VENT®



|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| LONGITUD | NP | RP | WP |
|----------|----|----|----|

ID00.10.018

## SCANBODY TITANIO ELEMENT BH



|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| LONGITUD | NP | RP | WP |
|----------|----|----|----|

ID00.10.018

## SCANBODY

### SCANBODY TITANIO MIS® SEVEN®

| LONGITUD                                                                          | NP          | RP          | WP          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | ID00.10.019 | ID00.10.018 | MI02.10.300 |

### SCANBODY PEEK PHIBO® AUREA EVO®

| LONGITUD                                                                          | NP          | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
|  | PH02.10.100 | PH02.10.200 |    |

### SCANBODY TITANIO BH


| LONGITUD                                                                            | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|
|  |    | ID00.10.018 |    |



# ELEMENT

## SCANBODY

NEODENT® GM®

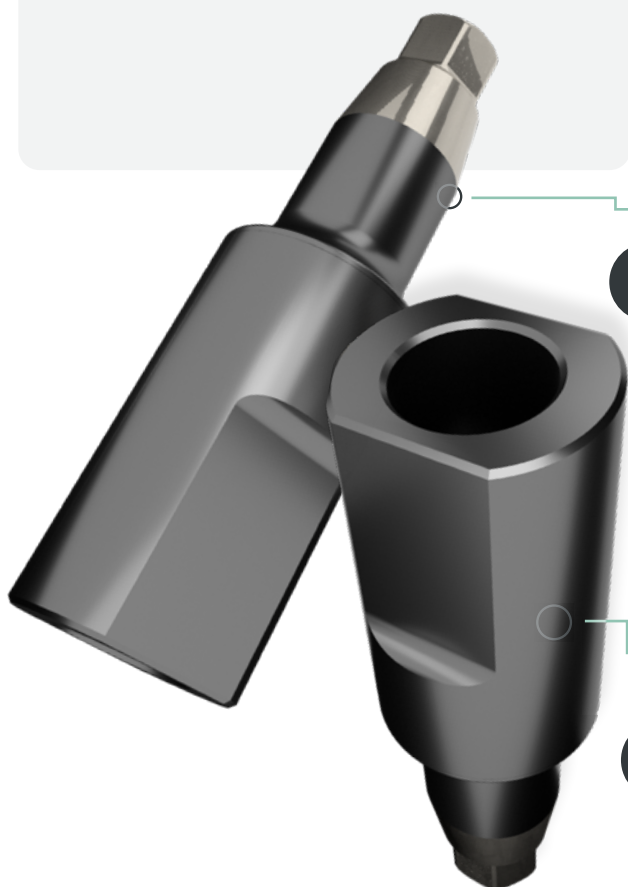


1

**Diseño en una sola pieza que evita microjuegos entre materiales, asegurando mayor precisión en el escaneo intraoral y de laboratorio.**

2

**Tratamiento superficial arenado para escaneo intraoral sin reflejos**

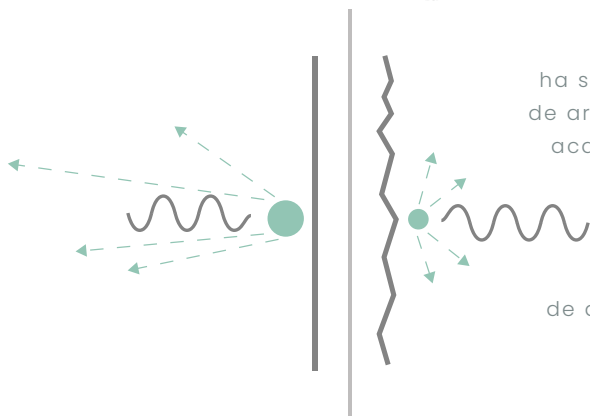

La superficie del scanbody ha sido sometida a un proceso de arenado que proporciona un acabado mate no reflectante.

Lo que facilita la captura de datos por parte de los escáneres intraorales, eliminando la necesidad de aplicar sprays opacadores.






## HEXÁGONO EXTERNO



# HEXÁGONO EXTERNO



UNIVERSAL

RP Ø 4.1

## TRANSFER HEXÁGONO EXTERNO

### ROTATORIO



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
|          |    | NB02.06.002 |    |

### ANTIROTATORIO



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
|          |    | NB02.06.003 |    |

## ANÁLOGO HEXÁGONO EXTERNO



| LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|----------|----|-------------|----|
|          |    | BT03.05.200 |    |

### DIGITAL



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
|          |    | ID00.05.001 |    |

## PILAR DE CICATRIZACIÓN HEXÁGONO EXTERNO



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 2.0 MM   |    | NB02.03.220 |    |
| 3.0 MM   |    | NB02.03.230 |    |
| 4.0 MM   |    | NB02.03.240 |    |

## HEXÁGONO EXTERNO UNIVERSAL

### PILAR PROVISIONAL HEXÁGONO EXTERNO

#### ROTATORIO



| LONGITUD | NP | RP           | WP |
|----------|----|--------------|----|
|          |    | NB02.07.200R |    |

#### ANTIROTATORIO



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
|          |    | NB02.07.200 |    |

### INTERFASE HEXÁGONO EXTERNO (2 PIEZAS)

#### ROTATORIO



| LONGITUD | NP | RP           | WP |
|----------|----|--------------|----|
| 0.5 MM   |    | NB02.08.205R |    |
| 1.5 MM   |    | NB02.08.215R |    |

#### ANTIROTATORIO



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 0.5 MM   |    | NB02.08.205 |    |
| 1.5 MM   |    | NB02.08.215 |    |

### SCANBODY HEXÁGONO EXTERNO



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
|          |    | ID00.10.017 |    |

## HEXÁGONO EXTERNO UNIVERSAL

### TRANSEPITELIAL HEXÁGONO EXTERNO MULTI UNIT 4.8

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | NB02.15.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | NB02.15.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | NB02.15.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | NB02.15.240 |    |

### PILAR LOCATOR HEXÁGONO EXTERNO

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | NB02.04.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | NB02.04.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | NB02.04.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | NB02.04.240 |    |

### TORNILLO HEXÁGONO EXTERNO

|                                                                                     | RECTO       | DINÁMICO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | RP          | RP / WP     |
|                                                                                     | BT03.02.001 | BT03.02.601 |
|  |             |             |
|                                                                                     |             |             |

## HEXÁGONO EXTERNO UNIVERSAL

### TRANSEPITELIAL HEX. EXT.(2 PIEZAS) MULTI IM 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | BT03.16.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | BT03.16.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | BT03.16.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | BT03.16.240 |    |

#### PLATTFORM SWITCHING (PS)

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 2.0 MM   |    | BT03.17.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | BT03.17.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | BT03.17.240 |    |

### TRANSEPITELIAL HEXÁGONO EXTERNO (2 PIEZAS) SRA 4.6

|                                                                                    | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | ST07.22.210 |    |


### TRANSEPITELIAL HEXÁGONO EXTERNO MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | NB02.14.210 |    |
|                                                                                     | 2.0 MM   |    | NB02.14.220 |    |
|                                                                                     | 3.0 MM   |    | NB02.14.230 |    |
|                                                                                     | 4.0 MM   |    | NB02.14.240 |    |

#### PLATTFORM SWITCHING (PS)

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | NB02.15.210 |    |
|                                                                                     | 2.0 MM   |    | NB02.15.220 |    |
|                                                                                     | 3.0 MM   |    | NB02.15.230 |    |
|                                                                                     | 4.0 MM   |    | NB02.15.240 |    |



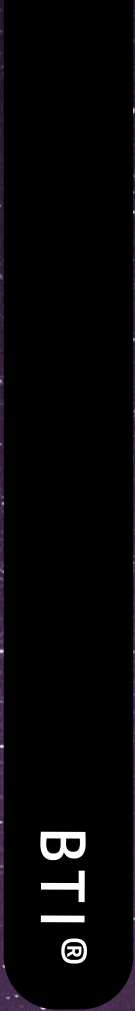

BTI®



27



**BTI®****INTERNO**

NP Ø 3.5

RP Ø 4.1

**ANÁLOGO INTERNO**LONGITUDNP Ø 3.5RP Ø 4.1WP

BT02.05.100

BT02.05.200

**PILAR DE CICATRIZACIÓN INTERNO**LONGITUDNPRPWP

2.0 MM

BT02.03.220

3.0 MM

BT02.03.230

4.0 MM

BT02.03.240

6.0 MM

BT02.03.260

**PILAR PROVISIONAL INTERNO ANTIROTATORIO**LONGITUDNPRPWP

BT02.07.100

BT02.07.200

## BTI® INTERNO

### INTERFASE INTERNO

#### RECTA



| LONGITUD | NP          | RP          | WP |
|----------|-------------|-------------|----|
| 0.5 MM   | BT02.08.105 | BT02.08.205 |    |
| 2.0 MM   | BT02.08.120 |             |    |
| 3.0 MM   | BT02.08.130 |             |    |
| 4.0 MM   | BT02.08.140 |             |    |

#### DINÁMICA



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 0.5 MM   |    | BT02.08.605 |    |

#### CUSTOM



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
|          |    | BT02.08.200 |    |

### SCANBODY INTERNO

#### TITANIO



| LONGITUD | NP          | RP | WP |
|----------|-------------|----|----|
|          | ID00.10.025 |    |    |

## PILAR LOCATOR INTERNO

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | BT02.04.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | BT02.04.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | BT02.04.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | BT02.04.240 |    |
|                                                                                   | 6.0 MM   |    | BT02.04.260 |    |

## TRANSEPITELIAL INTERNO COMPACT MULTI IM 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP Ø 3.5    | RP Ø 4.1    | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 0.5 MM   | BT02.22.105 | BT02.16.205 |    |
|                                                                                   | 1.0 MM   | BT02.22.110 | BT02.16.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   | BT02.22.120 | BT02.16.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   | BT02.22.130 | BT02.16.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   | BT02.22.140 | BT02.16.240 |    |

## PLATTFORM SWITCHING (DOS PIEZAS)

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 2.0 MM   |    | BT02.17.220 |    |
|                                                                                     | 3.0 MM   |    | BT02.17.230 |    |
|                                                                                     | 4.0 MM   |    | BT02.17.240 |    |

## TRANSEPITELIAL INTERNO MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NP Ø 3.5    | RP Ø 4.1    | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 1.0 MM   | BT02.14.110 | BT02.14.210 |    |
|                                                                                     | 2.0 MM   | BT02.14.120 | BT02.14.220 |    |
|                                                                                     | 3.0 MM   | BT02.14.130 | BT02.14.230 |    |
|                                                                                     | 4.0 MM   | BT02.14.140 | BT02.14.240 |    |

## BTI® INTERNO

### TRANSEPITELIAL INTERNO (2 PIEZAS) UNIT 4.1



| LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.5 MM   |    | BT02.12.215 |    |
| 2.0 MM   |    | BT02.12.220 |    |
| 4.0 MM   |    | BT02.12.240 |    |

#### PLATTFORM SWITCHING (PS)



| LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.5 MM   |    | BT02.13.215 |    |
| 2.0 MM   |    | BT02.13.220 |    |

### TORNILLO INTERNO

#### RECTO



| NP / RP / WP |
|--------------|
| BT02.02.001  |

#### DINÁMICO




| NP / RP / WP |
|--------------|
| BT02.02.501  |

#### MICRO HEAD



| NP / RP / WP |
|--------------|
| BT02.02.003  |



**BTI®****MULTI IM 4.1****TRANSFER MULTI IM 4.1**

LONGITUD

NP

RP

WP

BT01.06.001

**ANÁLOGO MULTI IM 4.1**

LONGITUD

NP

RP

WP

BT01.05.001

**DIGITAL**

LONGITUD

NP

RP

WP

ID00.05.002

**PILAR DE CICATRIZACIÓN MULTI IM 4.1****STANDARD**

RP

BT01.18.001

**SLIM**

RP

BT01.18.002

**REGISTRO OCLUSAL MULTI IM 4.1**

LONGITUD

NP

RP

WP

6.0 MM

BT01.18.060

9.0 MM

BT01.18.090

**SCANBODY TITANIO MULTI IM 4.1**

LONGITUD

NP

RP

WP

ID00.10.015

## BTI® MULTI IM 4.1

### PILAR PROVISIONAL MULTI IM 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | BT01.07.200 |    |

### INTERFASE MULTI IM 4.1

#### RECTA

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 0.5 MM   |    | BT01.08.005 |    |

#### CUSTOM ESTÉTICA

|                                                                                    | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | BT01.08.405 |    |

#### CUSTOM ESTÉTICA DINÁMICA

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | BT01.08.805 |    |

### TORNILLO MULTI IM 4.1 | UNIT 4.1 | MULTI UNIT 4.8

#### RECTO

| NP / RP / WP |
|--------------|
| BT01.02.002  |



#### DINÁMICO

| NP / RP / WP |
|--------------|
| BT01.02.001  |



#### M.U.A.

#### RECTO

| NP / RP / WP |
|--------------|
| ID00.02.004  |




#### DINÁMICO

| NP / RP / WP |
|--------------|
| ID00.02.005  |



BTI®



UNIT 4.1

## TRANSFER UNIT 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | BT01.06.002 |    |

## ANÁLOGO UNIT 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP Ø 4.1    | WP Ø 5.5    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|-------------|
|  |          |    | BT01.05.200 | BT01.05.300 |

## INTERFASE UNIT 4.1

## RECTA

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 0.5 MM   |    | BT01.08.201 |    |

## ESTÉTICA

|                                                                                     | LONGITUD         | NP | RP                         | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------------------|----|
|  | 0.5 MM<br>1.5 MM |    | BT01.08.205<br>BT01.08.215 |    |

## CUSTOM

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | BT01.08.601 |    |

## DINÁMICO

|                                                                                     | LONGITUD                | NP | RP                         | WP          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----------------------------|-------------|
|  | SHORT<br>LONG<br>0.5 MM |    | BT01.08.602<br>BT01.08.603 | BT01.08.701 |

## BTI® UNIT 4.1

### PILAR PROVISIONAL UNIT 4.1

| LONGITUD                                                                          | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|
|  |    | BT01.07.201 |    |

### SCANBODY TITANIO UNIT 4.1

| LONGITUD                                                                          | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|
|  |    | ID00.10.021 |    |

### TORNILLO MULTI IM 4.1 | UNIT 4.1 | MULTI UNIT 4.8

| RECTO                                                                                           | DINÁMICO                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NP / RP / WP                                                                                    | NP / RP / WP                                                                                    |
|  BT01.02.002 |  BT01.02.001 |
| M.U.A.                                                                                          |                                                                                                 |
| RECTO                                                                                           | DINÁMICO                                                                                        |
| NP / RP / WP                                                                                    | NP / RP / WP                                                                                    |
|  ID00.02.004 |  ID00.02.005 |

### TRANSPORTADOR UNIT 4.1


| SHORT                                                                                           | LONG                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP                                                                                              | RP                                                                                              |
|  BT01.01.020 |  BT01.01.025 |



STRAUMANN®



# STRAUMANN®



# TISSUE LEVEL®

RP Ø4.8

## TRANSFER TISSUE LEVEL®

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 6.0 MM   |    | ST01.06.200 |    |

## ANÁLOGO TISSUE LEVEL® Ø 4.8

|                                                                                    | LONGITUD | NP | RP Ø 4.8    | WP |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | ST01.05.200 |    |

## INTERFASE TISSUE LEVEL®

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 0.5 MM   |    | ST01.08.200 |    |

## SCANDOBY TITANIO TISSUE LEVEL®

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | ST01.10.200 |    |

## PILAR LOCATOR TISSUE LEVEL®

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | ST01.04.210 |    |
|                                                                                     | 2.0 MM   |    | ST01.04.220 |    |
|                                                                                     | 3.0 MM   |    | ST01.04.230 |    |
|                                                                                     | 4.0 MM   |    | ST01.04.240 |    |

# STRAUMANN® TISSUE LEVEL®

## TRANSEPITELIAL TISSUE LEVEL® MULTI UNIT 4.8



LONGITUD

NP

RP Ø 4.8

WP

1.0 MM

ST04.14.210

## TORNILLO TISSUE LEVEL®




LONGITUD

NP

RP

WP

ST01.02.201



## ANÁLOGO BLX®

|                                                                                   | LONGITUD | NB | RB / WB     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|
|  |          |    | ST03.05.200 |

## PILAR DE CICATRIZACIÓN BLX®

|                                                                                   | LONGITUD | NB | RB / WB     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|
|  | 2.0 MM   |    | ST03.03.220 |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | ST03.03.230 |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | ST03.03.250 |

## INTERFASE CUSTOM BLX®

### ROTATORIO

|                                                                                     | LONGITUD | NB | RB / WB      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------|
|  | 1.0 MM   |    | ST03.08.410R |
|                                                                                     | 2MM      |    | ST03.08.420R |
|                                                                                     | 3MM      |    | ST03.08.430R |

### ANTIROTATORIO

|                                                                                     | LONGITUD | NB | RB / WB     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|
|  | 1.0 MM   |    | ST03.08.410 |
|                                                                                     | 2MM      |    | ST03.08.420 |
|                                                                                     | 3MM      |    | ST03.08.430 |

## SCANBODY BLX®

|                                                                                     | LONGITUD | NB | RB / WB     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|
|  |          |    | ID00.10.026 |

## PILAR LOCATOR BLX®

|                                                                                   | LONGITUD | NB | RB / WB     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|
|  | 1.0 MM   |    | ST03.04.210 |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | ST03.04.220 |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | ST03.04.230 |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | ST03.04.240 |
|                                                                                   | 5.0 MM   |    | ST03.04.250 |
|                                                                                   | 6.0 MM   |    | ST03.04.260 |

## TRANSEPITELIAL BLX® MULTI UNIT 4.8

|                                                                                   | LONGITUD | NB | RB / WB     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|
|  | 1.5 MM   |    | ST03.14.215 |
|                                                                                   | 2.5 MM   |    | ST03.14.225 |
|                                                                                   | 3.5 MM   |    | ST03.14.235 |
|                                                                                   | 4.5 MM   |    | ST03.14.245 |

# STRAUMANN®



## BONE LEVEL®

NC Ø 3.3  
RC Ø 4.1

### ANÁLOGO BONE LEVEL®

|                                                                                   | LONGITUD | NC Ø 3.3    | RC Ø 4.1    | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  |          | ST02.05.100 | ST02.05.200 |    |

### PILAR DE CICATRIZACIÓN BONE LEVEL®

|                                                                                    | LONGITUD | NC          | RC          | WC |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 2.0 MM   | ST02.03.120 | ST02.03.220 |    |
|                                                                                    | 3.5 MM   | ST02.03.135 |             |    |
|                                                                                    | 4.0 MM   |             | ST02.03.240 |    |
|                                                                                    | 5.0 MM   | ST02.03.150 |             |    |
|                                                                                    | 6.0 MM   |             | ST02.03.260 |    |

### SCANBODY TITANIO BONE LEVEL®

|                                                                                     | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | ST02.10.200 |    |

### INTERFASE BONE LEVEL®

#### RECTA

|                                                                                     | LONGITUD | NC | RC          | WC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | ST02.08.210 |    |
|                                                                                     | 2.0 MM   |    | ST02.08.220 |    |

#### DINÁMICA

|                                                                                     | LONGITUD | NC | RC          | WC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | ST02.08.610 |    |
|                                                                                     | 2.0 MM   |    | ST02.08.620 |    |



# STRAUMANN® BONE LEVEL®

## PILAR LOCATOR BONE LEVEL®

|                                                                                   | LONGITUD | NC          | RC          | WC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 1.0 MM   | ST02.04.110 | ST02.04.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   | ST02.04.120 | ST02.04.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   | ST02.04.130 | ST02.04.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   | ST02.04.140 | ST02.04.240 |    |

## TRANSEPITELIAL BONE LEVEL® MULTI IM 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NC Ø 3.3    | RC Ø 4.1    | WC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 1.0 MM   | ST02.16.110 | ST02.16.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   | ST02.16.120 | ST02.16.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   | ST02.16.130 | ST02.16.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   | ST02.16.140 | ST02.16.240 |    |
|                                                                                   | 6.0 MM   |             | ST02.16.260 |    |

## TRANSEPITELIAL BONE LEVEL® MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NC Ø 3.3    | RC Ø 4.1    | WC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 1.5 MM   | ST02.14.115 | ST02.14.215 |    |
|                                                                                     | 2.5 MM   | ST02.14.125 | ST02.14.225 |    |
|                                                                                     | 3.5 MM   | ST02.14.135 | ST02.14.235 |    |
|                                                                                     | 4.5 MM   | ST02.14.145 | ST02.14.245 |    |

## TRANSEPITELIAL BONE LEVEL® SRA 4.6

|                                                                                     | LONGITUD | NC | RC Ø 4.1    | WC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.5 MM   |    | ST07.35.215 |    |
|                                                                                     | 2.5 MM   |    | ST07.35.225 |    |
|                                                                                     | 3.5 MM   |    | ST07.35.235 |    |
|                                                                                     | 4.5 MM   |    | ST07.35.245 |    |

## TORNILLO RECTO BONE LEVEL®

| RECTO                                                                               |             | DINÁMICO                                                                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | RC          |  | RC          |
|                                                                                     | ST02.02.001 |                                                                                     | ST02.02.004 |

**INTERFASE SYNOCTA®**

LONGITUD

NP

RP

WP

0.5 MM

ST04.08.200



**SCANBODY SYNOCTA®**

LONGITUD

NP

RP

WP

ID00.10.027



**TORNILLO SYNOCTA®**

RECTO

DINÁMICO

RP

RP

ST01.02.200

ST01.02.203



# ELEMENT


TRANSEPITELIAL  
ANGULADO **30°**

NEODENT® GM®


Conexión  
Multi Unit  
Universal

**2**

Superficie  
microestructurada  
y pulida en el perfil  
de emergencia que  
reduce la adhesión  
bacteriana y mejora  
la integración de  
tejidos blandos  
periimplantarios.

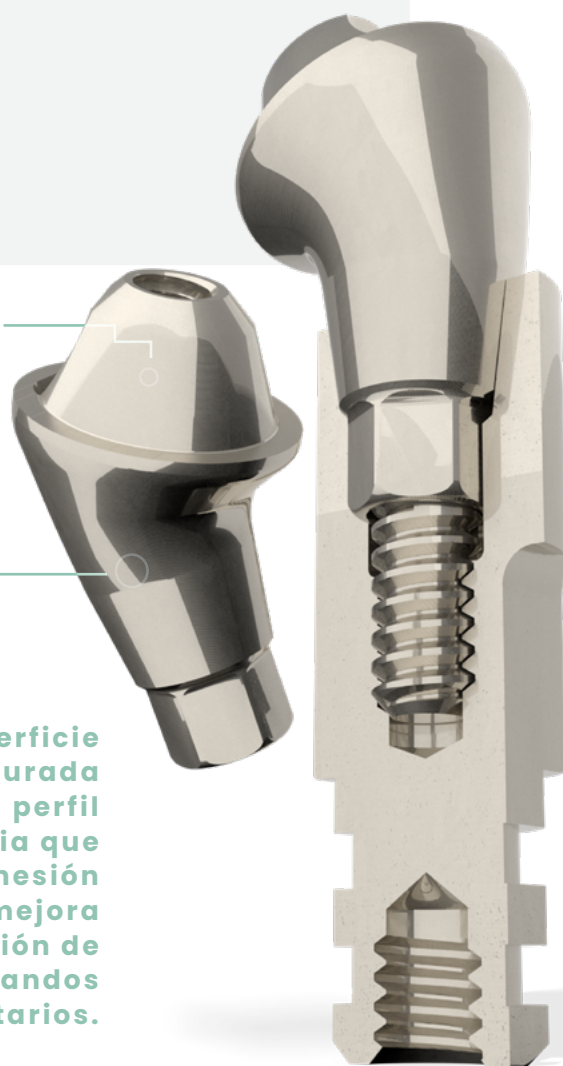



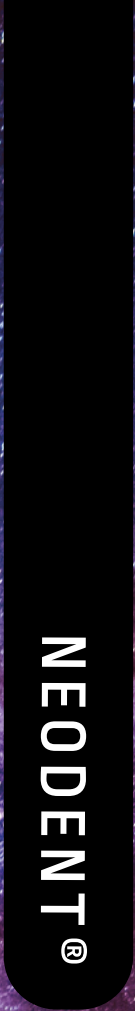

NEODENT®



# NEODENT®



# GM®

## TRANSFER GM®



LONGITUD

NP

GM

WP

NE02.06.200

## ANÁLOGO GM®



LONGITUD

NP

GM

WP

NE02.05.001

### DIGITAL



LONGITUD

NP

GM

WP

ID00.05.008

## PILAR DE CICATRIZACIÓN GM®



LONGITUD

NP

GM

WP

1.5 MM

NE02.03.115

NE02.03.215

2.5 MM

NE02.03.125

NE02.03.225

3.5 MM

NE02.03.135

NE02.03.235

4.5 MM

NE02.03.145

NE02.03.245

## PILAR PROVISIONAL GM®

### ROTATORIO



LONGITUD

NP

GM

WP

NE02.07.201

### ANTIROTATORIO



LONGITUD

NP

GM

WP

NE02.07.200



## INTERFASE GM®

## RECTA



| LONGITUD | NP | GM          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.0 MM   |    | NE02.08.210 |    |
| 2.0 MM   |    | NE02.08.220 |    |
| 3.0 MM   |    | NE02.08.230 |    |
| 4.0 MM   |    | NE02.08.240 |    |

## DINÁMICA



| LONGITUD | NP | GM          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.0 MM   |    | NE02.08.610 |    |
| 2.0 MM   |    | NE02.08.620 |    |
| 3.0 MM   |    | NE02.08.630 |    |
| 4.0 MM   |    | NE02.08.640 |    |

## CUSTOM



| LONGITUD | NP | GM          | WP |
|----------|----|-------------|----|
|          |    | NE02.08.201 |    |

## SCANBODY GM® TITANIO



| LONGITUD | NP | GM          | WP |
|----------|----|-------------|----|
|          |    | ID00.10.020 |    |

## PILAR LOCATOR GM®



| LONGITUD | NP | GM          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.0 MM   |    | NE02.04.210 |    |
| 2.0MM    |    | NE02.04.220 |    |
| 3.0 MM   |    | NE02.04.230 |    |
| 4.0 MM   |    | NE02.04.240 |    |
| 5.0 MM   |    | NE02.04.250 |    |
| 6.0 MM   |    | NE02.04.260 |    |

TRANSEPITELIAL GM® MULTI IM 4.1

|                                                                                   | LONGITUD | NP | GM          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 0.5 MM   |    | NE02.16.205 |    |
|                                                                                   | 1.0 MM   |    | NE02.16.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | NE02.16.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | NE02.16.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | NE02.16.240 |    |
|                                                                                   | 6.0 MM   |    | NE02.16.260 |    |

TRANSEPITELIAL GM® MULTI UNIT 4.8

0°

|                                                                                   | LONGITUD | NP | GM          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.5 MM   |    | NE02.14.215 |    |
|                                                                                   | 2.5 MM   |    | NE02.14.225 |    |
|                                                                                   | 3.5 MM   |    | NE02.14.235 |    |
|                                                                                   | 4.5 MM   |    | NE02.14.245 |    |

17°

|                                                                                     | LONGITUD | NP | GM          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.5 MM   |    | NE02.14.615 |    |
|                                                                                     | 2.5 MM   |    | NE02.14.625 |    |
|                                                                                     | 3.5 MM   |    | NE02.14.635 |    |

30°

|                                                                                     | LONGITUD | NP | GM          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.5 MM   |    | NE02.14.815 |    |
|                                                                                     | 2.5 MM   |    | NE02.14.825 |    |
|                                                                                     | 3.5 MM   |    | NE02.14.835 |    |

TORNILLO PILAR GM®

RECTO



GM

NE02.02.001

DINÁMICO



GM

NE02.02.002

TORNILLO GM®

RECTO



GM

NE02.02.006


DINÁMICO



GM

NE02.02.005



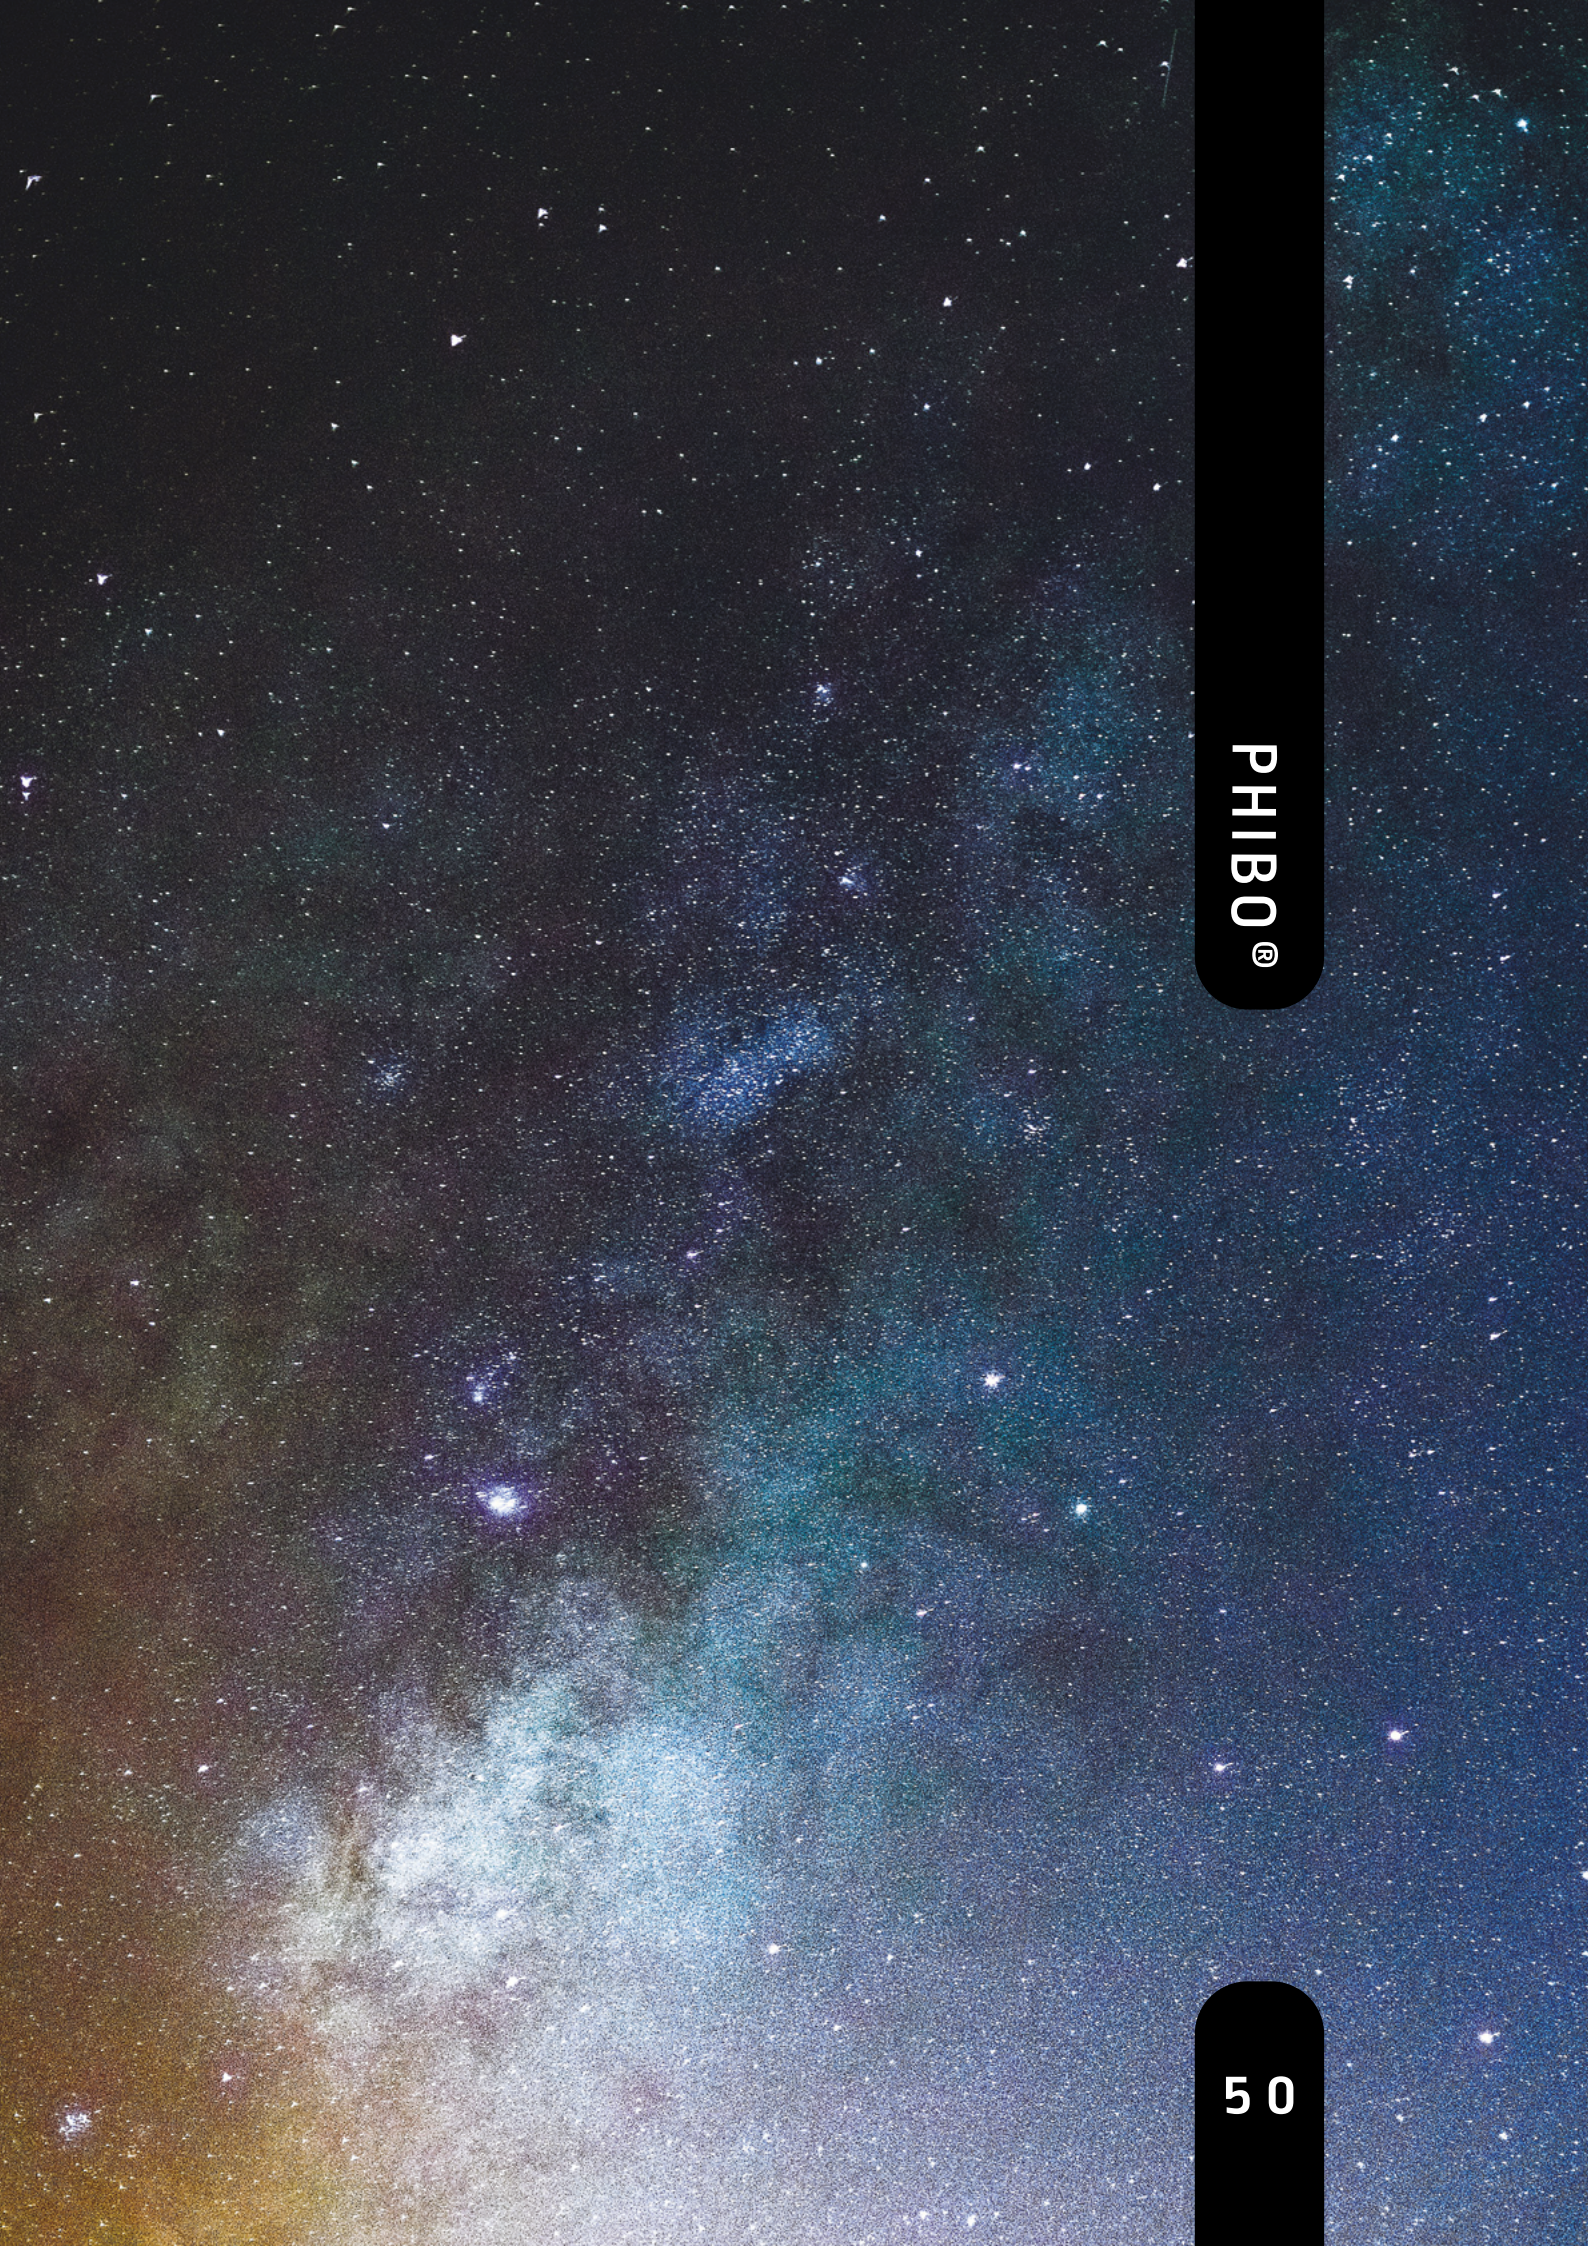


PHIBO®

50



**PHIBO®**



**AUREA EVO®**

NP Ø 3.5

RP Ø 4.3 / Ø 4.8

WP Ø 5.5

### ANÁLOGO AUREA EVO®



LONGITUD

NP Ø 3.5

RP Ø 4.3 / Ø 4.8

WP

PH02.05.100

PH02.05.200

### INTERFASE AUREA EVO®

#### RECTA



LONGITUD

NP

RP

WP

1.0 MM

PH02.08.110

PH02.08.210

2.0 MM

PH02.08.120

PH02.08.220

3.0 MM

PH02.08.130

PH02.08.240

4.0 MM

PH02.08.140

PH02.08.230

#### DINÁMICA



LONGITUD

NP

RP

WP

1.0 MM

PH02.08.510

PH02.08.610

2.0 MM

PH02.08.520

PH02.08.620

3.0 MM

PH02.08.530

PH02.08.630

4.0 MM

PH02.08.540

PH02.08.640

#### CUSTOM



LONGITUD

NP

RP

WP

PH02.08.100

PH02.08.201

### SCANBODY AUREA EVO®



LONGITUD

NP

RP

WP

PH02.10.100

PH02.10.200



# PHIBO® AUREA EVO®

## TRANSEPITELIAL AUREA EVO® MULTI UNIT 4.8



| LONGITUD | NP Ø 3.5    | RP Ø 4.3/ Ø 4.8 | WP Ø 5.5    |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 0.5 MM   | PH02.14.105 | PH02.14.205     |             |
| 1.0 MM   | PH02.14.110 | PH02.14.210     |             |
| 2.0 MM   | PH02.14.120 | PH02.14.220     | PH02.14.320 |
| 3.0 MM   | PH02.14.130 | PH02.14.230     |             |
| 4.0 MM   | PH02.14.140 | PH02.14.240     |             |

## TORNILLO AUREA EVO®

### RECTO



| LONGITUD | NP          | RP          | WP |
|----------|-------------|-------------|----|
| 1.20 MM  |             | PH02.02.001 |    |
| 1.25 MM  | PH02.02.003 | PH02.02.002 |    |

### DINÁMICO



| LONGITUD | NP          | RP          | WP |
|----------|-------------|-------------|----|
|          | PH02.02.005 | PH02.02.004 |    |



MIS®



## SEVEN® HEXÁGONO INTERNO

NP Ø 3.5  
RP Ø 3.75 / 4.2  
WP Ø 5.0

### TRANSFER SEVEN®



| LONGITUD | NP          | RP          | WP          |
|----------|-------------|-------------|-------------|
|          | MI02.06.300 | MI02.06.100 | MI02.06.200 |

### ANÁLOGO SEVEN®



| LONGITUD | NP Ø 3.5    | RP Ø 3.75/4.20 | WP Ø 5.0    |
|----------|-------------|----------------|-------------|
|          | MI02.05.003 | MI02.05.001    | MI02.05.002 |

### DIGITAL



| LONGITUD | NP          | RP          | WP          |
|----------|-------------|-------------|-------------|
|          | ID00.05.010 | ID00.05.009 | ID00.05.011 |

### PILAR DE CICATRIZACIÓN SEVEN®



| LONGITUD | NP | RP          | WP          |
|----------|----|-------------|-------------|
| 1.5 MM   |    | MI02.03.215 | MI02.03.315 |
| 2.5 MM   |    | MI02.03.225 | MI02.03.325 |
| 3.5 MM   |    | MI02.03.235 | MI02.03.335 |
| 4.5 MM   |    | MI02.03.245 | MI02.03.345 |

### PILAR LOCATOR SEVEN®



| LONGITUD | NP | RP          | WP          |
|----------|----|-------------|-------------|
| 1.0 MM   |    | MI02.04.210 | MI02.04.310 |
| 2.0 MM   |    | MI02.04.220 | MI02.04.320 |
| 3.0 MM   |    | MI02.04.230 | MI02.04.330 |
| 4.0 MM   |    | MI02.04.240 | MI02.04.340 |

### SCANBODY TITANIO SEVEN®



| LONGITUD | NP          | RP          | WP          |
|----------|-------------|-------------|-------------|
|          | ID00.10.019 | ID00.10.018 | MI02.10.300 |

INTERFASE SEVEN®

|                                                                                   | LONGITUD | NP          | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 0.5 MM   | MI02.08.110 | MI02.08.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   | MI02.08.120 | MI02.08.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   | MI02.08.130 | MI02.08.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   | MI02.08.140 | MI02.08.240 |    |

DINÁMICA

|                                                                                   | LONGITUD | NP          | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  | 1.0 MM   | MI02.08.510 | MI02.08.610 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   | MI02.08.520 | MI02.08.620 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   | MI02.08.530 | MI02.08.630 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   | MI02.08.540 | MI02.08.640 |    |

CUSTOM

|                                                                                    | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | MI02.08.200 |    |

TRANSEPITELIAL SEVEN® MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NP Ø 3.5    | RP Ø3.75/4.2 | WP Ø 5.0    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|
|  | 1.0 MM   | MI02.14.110 | MI02.14.210  | MI02.14.310 |
|                                                                                     | 2.0 MM   | MI02.14.120 | MI02.14.220  | MI02.14.320 |
|                                                                                     | 3.0 MM   | MI02.14.130 | MI02.14.230  | MI02.14.330 |
|                                                                                     | 4.0 MM   | MI02.14.140 | MI02.14.240  | MI02.14.340 |

TORNILLO SEVEN®


RECTO

|                                                                                     | LONGITUD | NP          | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  |          | MI02.02.100 | MI02.02.200 |    |

DINÁMICO

|                                                                                     | LONGITUD | NP          | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----|
|  |          | MI02.02.500 | MI02.02.600 |    |



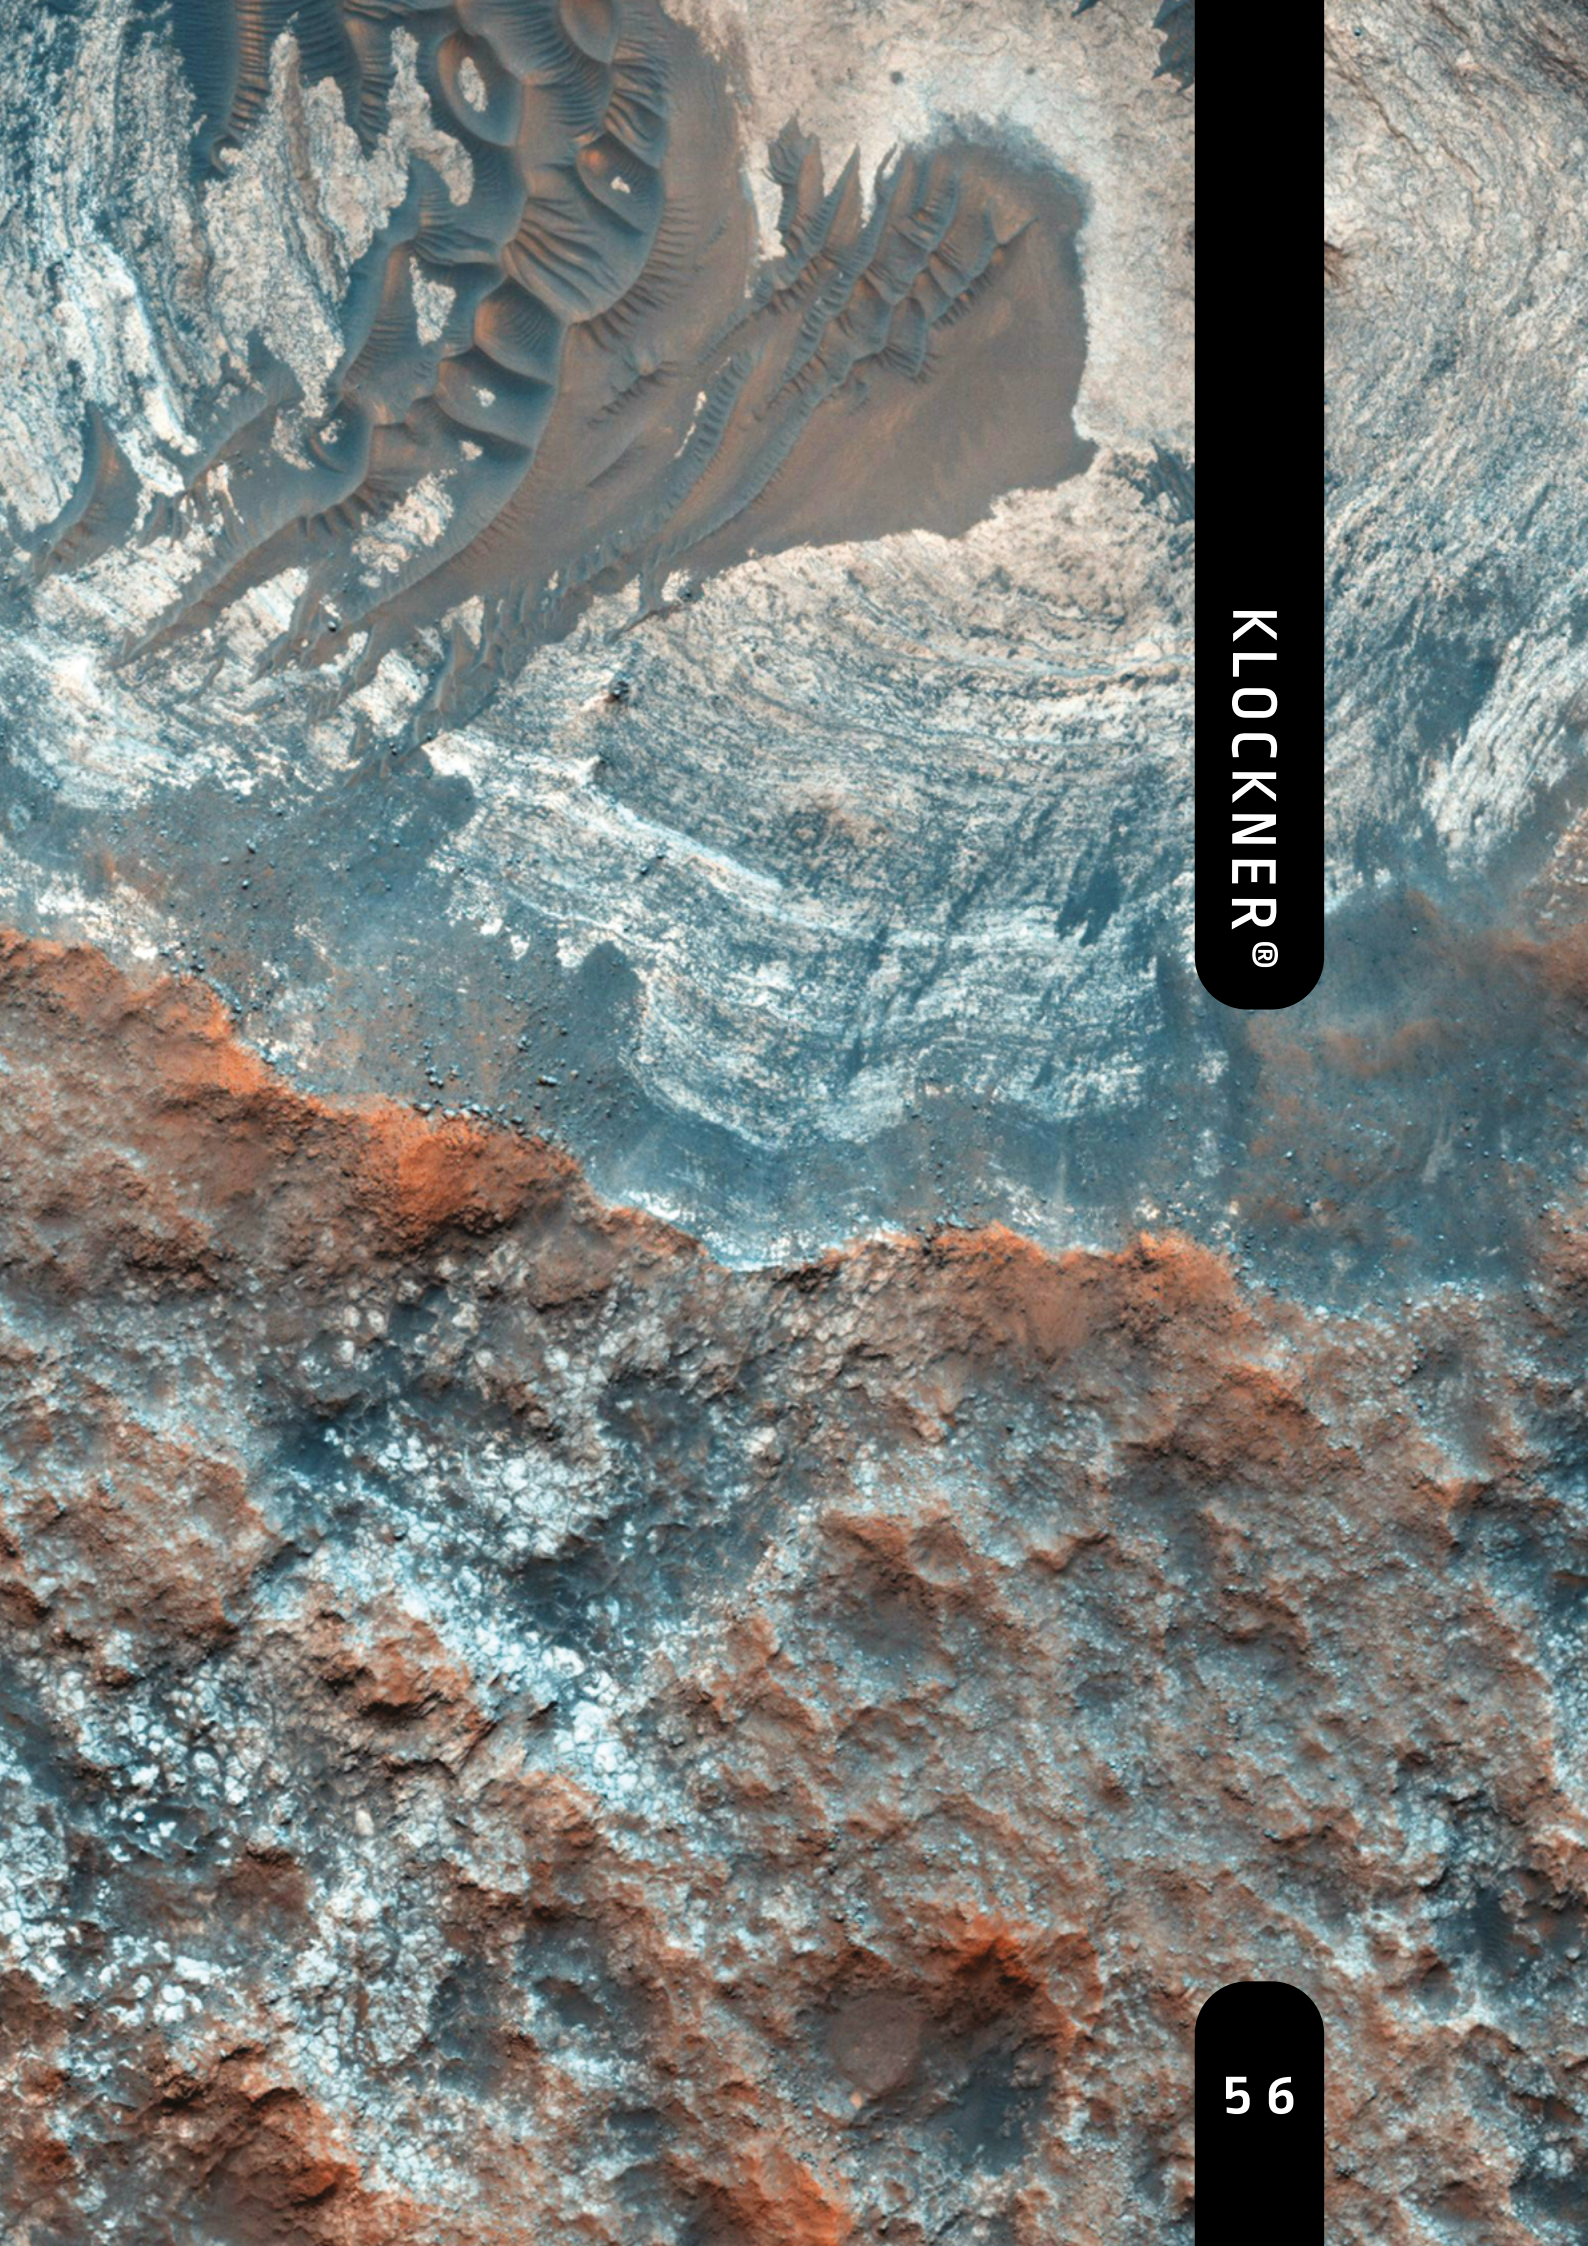

KLOCKNER®





## TRANSEPITELIAL VEGA® MULTI UNIT 4.8



| LONGITUD | NV          | RV          | WV |
|----------|-------------|-------------|----|
| 1.5 MM   | KL04.14.115 | KL04.14.215 |    |
| 2.5 MM   | KL04.14.125 | KL04.14.225 |    |
| 3.5 MM   | KL04.14.135 | KL04.14.235 |    |
| 4.5 MM   | KL04.14.145 | KL04.14.245 |    |

## ANÁLOGO VEGA®



| LONGITUD | NV          | RV          | WV |
|----------|-------------|-------------|----|
|          | KL04.05.100 | KL04.05.200 |    |

### DIGITAL



| LONGITUD | NV          | RV          | WV |
|----------|-------------|-------------|----|
|          | ID00.05.012 | ID00.05.013 |    |

## SCANBODY VEGA®



| LONGITUD | NV          | RV | WV |
|----------|-------------|----|----|
|          | ID00.10.028 |    |    |

## INTERFASE ANTIROTATORIA

### ANTIROTATORIO



| LONGITUD | NV          | RV          | WV |
|----------|-------------|-------------|----|
| 1.0 MM   | KL04.08.110 | KL04.08.210 |    |
| 2.0 MM   | KL04.08.120 | KL04.08.220 |    |
| 3.0 MM   | KL04.08.130 | KL04.08.230 |    |
| 4.0 MM   | KL04.08.140 | KL04.08.240 |    |

# ELEMENT

TRANSEPITELIAL  
MULTI IM **4.1**


NEODENT® GM®



**1**


**Diseño anatómico con perfil estrecho y expansión en la plataforma protésica**

Presenta un cuerpo delgado que se ensancha únicamente en la plataforma protésica, facilitando una conformación gingival más natural y estética.

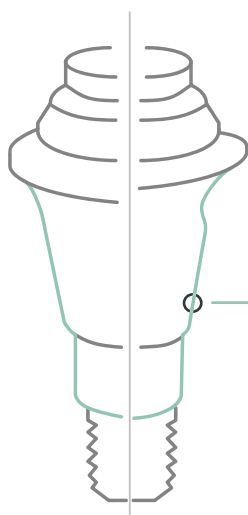


***Menos Titanio,  
Más Tejido***



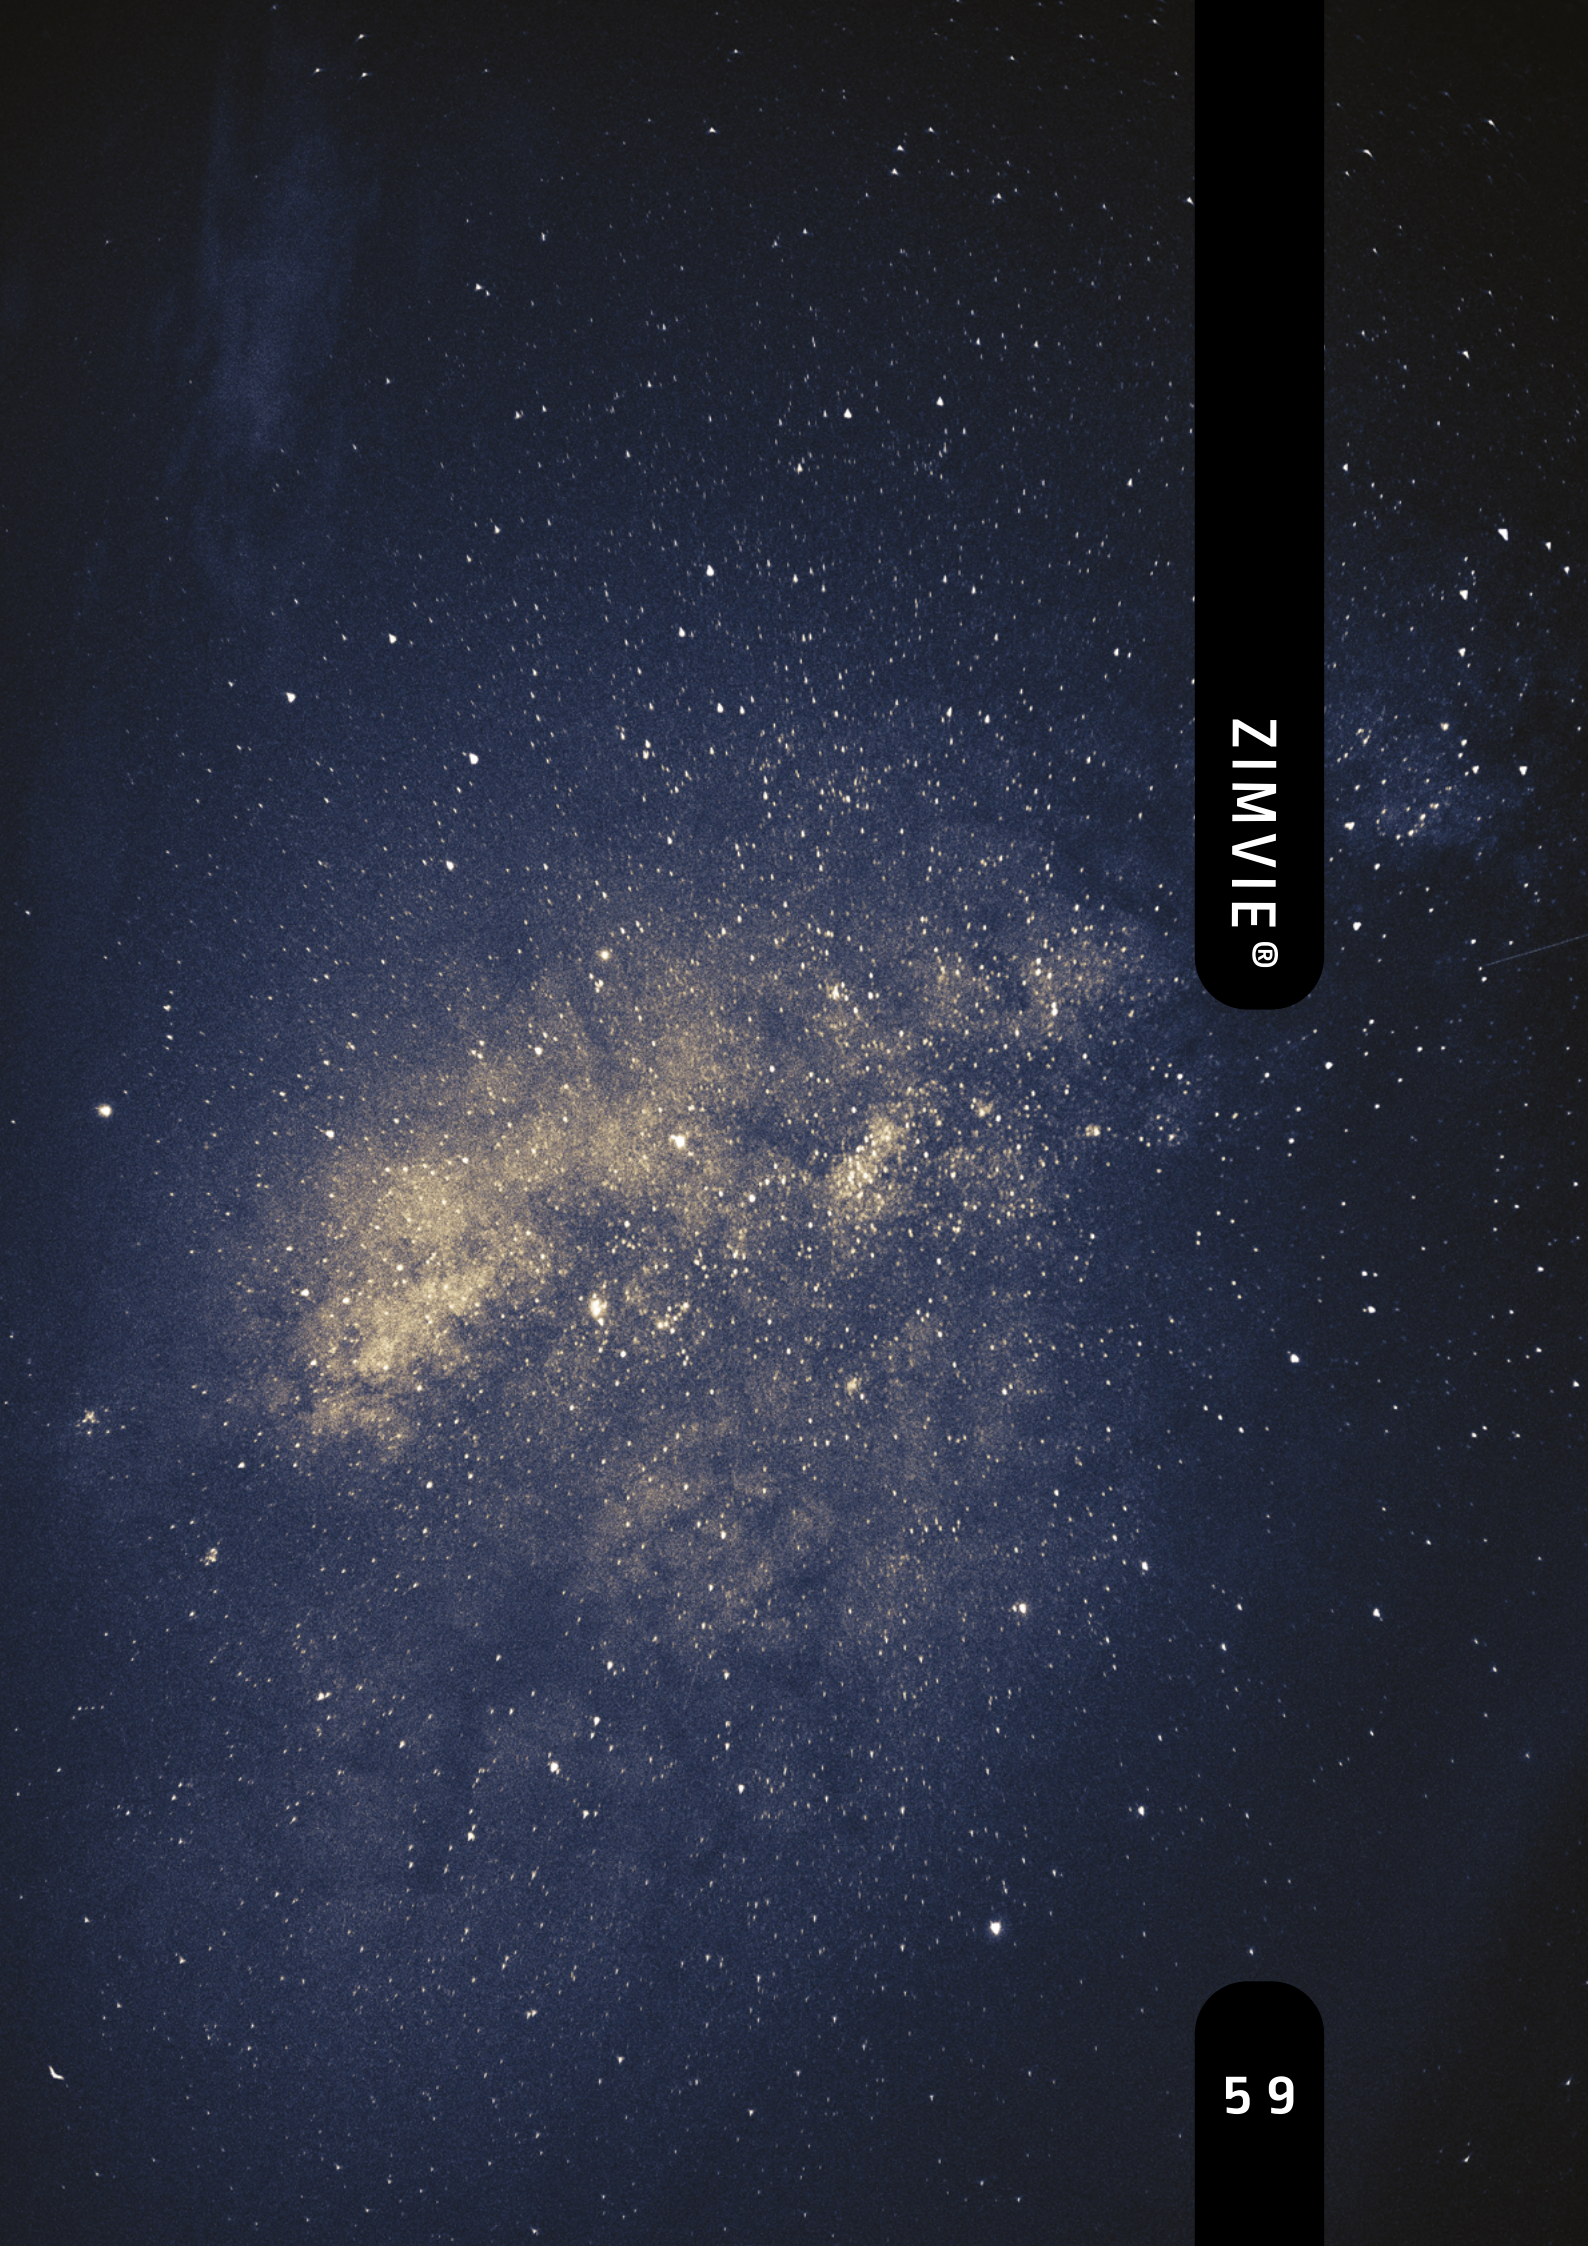

ZIMVIE®



**ZIMVIE®****SCREW-VENT®**

RP Ø 3.75 / 4.2

**TRANSFER SCREW-VENT®**

LONGITUD

NP

RP

WP



MI02.06.100

**ANÁLOGO SCREW-VENT®**

LONGITUD

NP

RP Ø3.75/4.20

WP



MI02.05.001

**DIGITAL**

LONGITUD

NP

RP

WP



ID00.05.009

**PILAR DE CICATRIZACIÓN SCREW-VENT®**

LONGITUD

NP

RP

WP



1.5 MM

MI02.03.215

MI02.03.315

2.5 MM

MI02.03.225

MI02.03.325

3.5 MM

MI02.03.235

MI02.03.335

4.5 MM

MI02.03.245

MI02.03.345

**PILAR LOCATOR SCREW-VENT®**

LONGITUD

NP

RP

WP



1.0 MM

MI02.04.210

2.0 MM

MI02.04.220

3.0 MM

MI02.04.230

4.0 MM

MI02.04.240

**SCANBODY TITANIO SCREW-VENT®**

LONGITUD

NP

RP

WP



ID00.10.018

## ZIMVIE® SCREW-VENT®

### INTERFASE SCREW-VENT®

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 0.5 MM   |    | MI02.08.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | MI02.08.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | MI02.08.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | MI02.08.240 |    |

#### DINÁMICA

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | MI02.08.610 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | MI02.08.620 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | MI02.08.630 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | MI02.08.640 |    |

#### CUSTOM

|                                                                                    | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | MI02.08.200 |    |

### TRANSEPITELIAL SCREW-VENT® MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NP Ø 3.5 | RP Ø3.75/4.2 | WP Ø 5.0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|
|  | 1.0 MM   |          | MI02.14.210  |          |
|                                                                                     | 2.0 MM   |          | MI02.14.220  |          |
|                                                                                     | 3.0 MM   |          | MI02.14.230  |          |
|                                                                                     | 4.0 MM   |          | MI02.14.240  |          |

### TORNILLO SCREW-VENT®

#### RECTO


| RP          |
|-------------|
| MI02.02.200 |



#### DINÁMICO

| RP          |
|-------------|
| MI02.02.600 |



**ZIMVIE®****3I CERTAIN®**NP Ø3.4  
RP Ø4.1**ANÁLOGO 3I CERTAIN®**LONGITUDNPRP Ø 4.1WP

BI02.05.200

**TRANSEPTILIAL 3I CERTAIN® MULTI UNIT 4.8**LONGITUDNP Ø3.4RP Ø 4.1WP

0.5 MM

BI02.14.105

BI02.14.205

1.5 MM

BI02.14.110

BI02.14.210

2.5 MM

BI02.14.120

BI02.14.220

3.5 MM

BI02.14.130

BI02.14.230

4.5 MM

BI02.14.140

BI02.14.240


**TORNILLO 3I CERTAIN®**LONGITUDNP / RP / WP

BI02.02.200

# ELEMENT

PILAR  
PROVISIONAL  
ANTIROTATORIO **GM<sup>®</sup>**

NEODENT<sup>®</sup> GM<sup>®</sup>

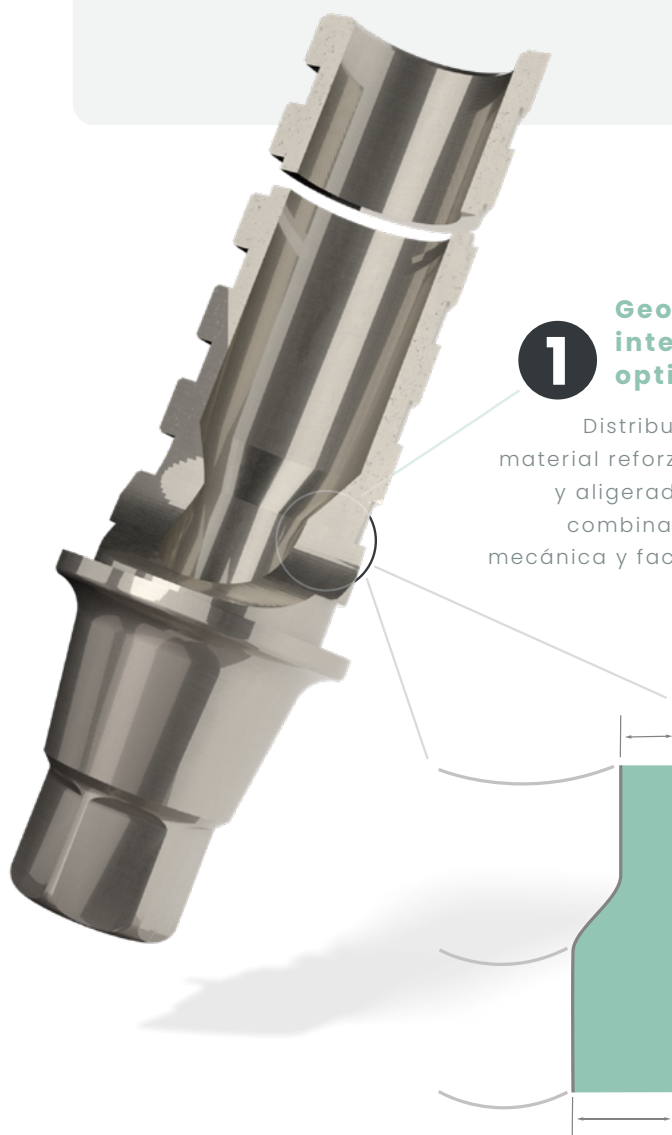

**1**


**Geometría  
interna  
optimizada**

Distribución interna de material reforzada en la base y aligerada en la corona, combinando resistencia mecánica y facilidad de corte.





ELEMENT



## TRANSFER BH

| LONGITUD                                                                          | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|
|  |    | MI02.06.100 |    |

## ANÁLOGO BH

| LONGITUD                                                                          | NP | RP Ø3.75/4.20 | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----|
|  |    | MI02.05.001   |    |

## DIGITAL

| LONGITUD                                                                            | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|
|  |    | ID00.05.009 |    |

## PILAR DE CICATRIZACIÓN BH

| LONGITUD                                                                            | NP | RP          | WP          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
|  |    |             |             |
| 1.5 MM                                                                              |    | MI02.03.215 | MI02.03.315 |
| 2.5 MM                                                                              |    | MI02.03.225 | MI02.03.325 |
| 3.5 MM                                                                              |    | MI02.03.235 | MI02.03.335 |
| 4.5 MM                                                                              |    | MI02.03.245 | MI02.03.345 |

## PILAR LOCATOR BH

| LONGITUD                                                                            | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|
|  |    |             |    |
| 1.0 MM                                                                              |    | MI02.04.210 |    |
| 2.0 MM                                                                              |    | MI02.04.220 |    |
| 3.0 MM                                                                              |    | MI02.04.230 |    |
| 4.0 MM                                                                              |    | MI02.04.240 |    |

## SCANBODY TITANIO BH

| LONGITUD                                                                            | NP | RP          | WP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|
|  |    | ID00.10.018 |    |

## ELEMENT BH

### INTERFASE BH

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 0.5 MM   |    | MI02.08.210 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | MI02.08.220 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | MI02.08.230 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | MI02.08.240 |    |

#### DINÁMICA

|                                                                                   | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  | 1.0 MM   |    | MI02.08.610 |    |
|                                                                                   | 2.0 MM   |    | MI02.08.620 |    |
|                                                                                   | 3.0 MM   |    | MI02.08.630 |    |
|                                                                                   | 4.0 MM   |    | MI02.08.640 |    |

#### CUSTOM

|                                                                                    | LONGITUD | NP | RP          | WP |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|----|
|  |          |    | MI02.08.200 |    |
|                                                                                    |          |    |             |    |

### TRANSEPITELIAL BH MULTI UNIT 4.8

|                                                                                     | LONGITUD | NP Ø 3.5 | RP Ø3.75/4.2 | WP Ø 5.0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|
|  | 1.0 MM   |          | MI02.14.210  |          |
|                                                                                     | 2.0 MM   |          | MI02.14.220  |          |
|                                                                                     | 3.0 MM   |          | MI02.14.230  |          |
|                                                                                     | 4.0 MM   |          | MI02.14.240  |          |

### TORNILLO BH

#### RECTO

| RP          |
|-------------|
| MI02.02.200 |



#### DINÁMICO

| RP          |
|-------------|
| MI02.02.600 |



## TORX T6 RECTO



| LONGITUD | REF         |
|----------|-------------|
| 20 MM    | ID00.93.020 |
| 25 MM    | ID00.93.025 |
| 30 MM    | ID00.93.030 |
| 40 MM    | ID00.93.040 |

## TORX T6 DINÁMICO



| LONGITUD | REF         |
|----------|-------------|
| 20 MM    | ID00.93.120 |
| 25 MM    | ID00.93.125 |
| 30 MM    | ID00.93.130 |

## HEXAGONAL



Ø 1.20 MM



Ø 1.22 MM



Ø 1.25 MM



Ø 1.27 MM



Ø 1.30 MM

| LONGITUD | REF         |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25 MM    | ID00.91.125 | ID00.91.225 | ID00.91.425 | ID00.91.325 | ID00.91.525 |
| 35 MM    | ID00.91.135 | ID00.91.235 | ID00.91.435 | ID00.91.335 | ID00.91.535 |

## CUADRADA



| LONGITUD | REF         |
|----------|-------------|
| 20 MM    | ID00.96.125 |
| 25 MM    | ID00.96.135 |

## TRANSEP. MULTI-UNIT



| LONGITUD | REF         |
|----------|-------------|
| 20 MM    | ID00.94.220 |



# ELEMENT TOOLS

## MANGO OSTEOTOMO



REF

ID00.27.001

## DESTORNILLADOR



LARGO

ID00.27.002



CORTO

ID00.27.004

## CONEXIÓN A CARRACA



REF

ID00.27.003

## CARRACA



REF

ID00.29.200

# ELEMENT



# ZYGOMA

## TRANSEPITELIAL EXTERNO CIGOMÁTICO

### MULTI IM 4.1



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.0 MM   |    | ID00.12.210 |    |
| 2.0 MM   |    | ID00.12.220 |    |
| 3.0 MM   |    | ID00.12.230 |    |
| 4.0 MM   |    | ID00.12.240 |    |

### MULTI UNIT 4.8



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.0 MM   |    | ID00.14.210 |    |
| 2.0 MM   |    | ID00.14.220 |    |
| 3.0 MM   |    | ID00.14.230 |    |
| 4.0 MM   |    | ID00.14.240 |    |

### SRA 4.6



| LONGITUD | NP | RP          | WP |
|----------|----|-------------|----|
| 1.0 MM   |    | ST07.22.210 |    |

## Política de Garantía

### 1. CONDICIONES GENERALES

1.1. Estos términos y condiciones de garantía cubren toda la gama de productos fabricados y distribuidos por INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN MECANIZADO MEDICO (en adelante, "ELEMENT").

1.2. La garantía descrita se presta de forma exclusiva a los clientes de ELEMENT que hayan adquirido de forma directa productos fabricados por ELEMENT, debiendo contar con la correspondiente factura de compra del producto adquirido.

1.3. A los anteriores efectos, únicamente se considerará "Cliente" de ELEMENT, y por tanto, beneficiario de la garantía, los clínicos, técnicos o protésicos dentales colegiados y/o las sociedades profesionales constituidas al menos por uno de los referidos profesionales dentales colegiados. Por tanto, la ejecución de la presente garantía no será exigible por terceros distintos a los anteriores.

1.4. En virtud de esta garantía, ELEMENT sustituirá los productos que presenten defectos de fabricación.

1.5. A partir de la fecha de entrega de los productos, el Cliente asume todos los riesgos y responsabilidades derivados del uso de los productos adquiridos, tanto si se emplean por separado o en conjunto con otros productos.

### 2. ALCANCE DE LA GARANTÍA PARA PRODUCTOS DE ELEMENT

2.1. ELEMENT ofrece una garantía de por vida en todos sus productos a partir de la fecha de su comercialización.

2.2. Para ello, el Cliente debe acreditar los siguientes requisitos:  
I. No haber combinado los productos de ELEMENT con los productos de otros fabricantes de componentes compatible.

II. Justificar correctamente haber realizado un uso y mantenimiento adecuado de los productos siguiendo las instrucciones de uso del producto de ELEMENT de acuerdo con las prácticas comúnmente aceptadas en odontología, excluyendo así cualquier uso indebido, abuso, negligencia, manipulación o almacenamiento contrario a éstas

III. Devolver el producto defectuoso correctamente esterilizado y embolsado.

IV. Aportar el formulario de garantía completamente cumplimentado, así como la factura original de la adquisición del producto ELEMENT.

V. Encontrarse al corriente en los pagos debidos a la empresa en el momento en el que presente la reclamación.

VI. Haber respetado el periodo de osteointegración y de cicatrización.

2.3. No se considerarán incluidos, y por lo tanto no cubiertos en el presente programa de garantía de ELEMENT:

Los productos fabricados a medida o especialmente modificados. Los Pilares una vez transformados formando parte de la prótesis dental.

Cuando el fallo derive de un accidente, trauma o daño causado por terceros.

Cuando el fallo en el producto se deba al desgaste y uso normal.

Cuando todos los procedimientos que emplean los productos dañados no se hubiesen realizado siguiendo las instrucciones de uso de los productos de la marca ELEMENT, ni siguiendo las prácticas comúnmente aceptadas en odontología.

Utilización del producto con accesorios, complementos y otros productos de un tipo, condición o normas no establecidas por ELEMENT.

Cuando los productos hayan sido modificados para alterar sus funciones o capacidades sin la autorización previa de ELEMENT.

### 3. LIMITACIONES GENERALES DE ESTA GARANTÍA

3.1. ELEMENT en nombre de sí misma, de sus representantes y de terceras partes fabricantes o distribuidoras de los productos rechaza:

a) Cualquier otra garantía, convenio u otro compromiso, expreso o implícito, oral o escrito, respecto de los productos (sin limitación) incluyendo garantías implicadas en la Comercialización, durabilidad o idoneidad para usos o propósitos particulares.

b) Cualquier responsabilidad respecto al daño ocasionado directo, indirecto, resultante o consecuencia del diseño, composición, estado, uso o desarrollo de la prótesis dental en la que se encuentran integrados los productos.

### 4. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

4.1. Para recibir los beneficios bajo estos términos y condiciones de garantía, el Cliente deberá solicitar el formulario de garantía a Atención al Cliente al correo: pedidos@element-dental.com, dentro del periodo de 30 días posteriores a la detección del defecto o no conformidad del producto.

4.2. Una vez recibida la solicitud de garantía, Atención al cliente facilitará al Cliente el formulario de garantía de calidad, indicando el número de reclamación asignada.

4.3. El cliente deberá:

a) presentar el formulario de garantía debidamente cumplimentado y firmado, así como la documentación solicitada en dicho formulario por correo electrónico a la dirección pedidos@element-dental.com.

b) enviar el producto defectuoso, una vez esterilizado y embolsado, junto con la documentación original necesaria a las oficinas de ELEMENT situadas en calle Riera de Montealegre 50 08915 Badalona (Barcelona). Los gastos derivados de esta gestión serán asumidos por el Cliente.

c) junto con la solicitud de devolución, certificar y acompañar la documentación que acredite el cumplimiento de todos los procedimientos implicados en el producto y que se han realizado según las instrucciones de ELEMENT, así como siguiendo las prácticas comúnmente aceptadas en odontología.

4.4. ELEMENT sólo realizará la gestión y el análisis interno de los casos una vez recibido el producto defectuoso y la totalidad de la documentación e información que sea requerida al efecto por ELEMENT

4.5. Transcurrido un plazo máximo de 30 días, a contar desde la recepción íntegra del producto defectuoso y la totalidad de la documentación e información que sea requerida, ELEMENT emitirá un informe sobre la incidencia abierta y comunicará, en base al análisis realizado, al interesado la aceptación o no de la garantía solicitada.

En caso de que se requiera información adicional durante este periodo, el plazo se interrumpirá y reanudará una vez facilitada la documentación adicional solicitada.

4.6. El coste de envío del producto de reemplazo será asumido en todos los casos por ELEMENT

### 5. MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA GARANTÍA

5.1. ELEMENT se reserva el derecho a modificar o finalizar este programa de garantía en cualquier momento y sin previo aviso. Los cambios o la finalización de la garantía no afectarán a los productos sujetos a la garantía y reportados a ELEMENT con anterioridad a la fecha del cambio o cancelación.

5.2. La versión en español de estos términos y condiciones de garantía prevalecerá sobre cualquier traducción en caso de que exista algún conflicto o discrepancia en su interpretación.

Política de garantía de Investigación y Desarrollo en Mecanizado Medico SL  
Fecha 01/01/2025

### Política de Envíos - Element Abutments

En Element Abutments nos comprometemos a ofrecer un servicio rápido y eficiente para que recibas tus productos de la mejor calidad. A continuación, detallamos nuestra política de envíos:

Coste de Envío:

Envíos gratuitos para pedidos superiores a 200€.

Para pedidos de menos de 200€, se aplicará un coste de envío de 5€.

Tiempo de Entrega:

Los pedidos realizados antes de las 14:00h serán procesados y enviados en un plazo de 24 horas.

Si el pedido se realiza después de las 14:00h, la entrega se realizará en 1 día más de lo habitual.

Nota: Los tiempos de entrega pueden verse afectados por condiciones ajenas a nuestro control, como incidencias de transporte o circunstancias excepcionales.

Gracias por confiar en Element Abutments, donde la precisión y la innovación son nuestra prioridad.

CATÁLOGO\_ABUTMENTS\_Rev.01-(JUN-25)

**ELEMENT**  
A B U T M E N T S

---

## Element E-Commerce

Explora la gama completa de aditamentos  
y realiza tu pedido en línea.  
[www.element-dental.com](http://www.element-dental.com)

---

## Element Customer Service

Contacta con nuestro equipo de servicio al cliente o  
con su representante de ventas:

Atención telefónica

**(+34) 679 86 77 98**

[pedidos@element-dental.com](mailto:pedidos@element-dental.com)

**E L E M E N T**

Todos los derechos reservados. Element Corp, el logotipo de Element y otras marcas registradas son propiedad de Element Corp. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una concesión, por implicación o de otro modo, de ninguna licencia o derecho de uso sobre cualquier marca registrada de Element. Para más información sobre términos y condiciones de venta, limitaciones de garantía y disponibilidad de productos, visite: [element-dental.com](http://element-dental.com)

La disponibilidad de productos está sujeta a la regulación local. Para obtener información más detallada sobre indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones, consulte las instrucciones de uso proporcionadas con cada producto o en el sitio web mencionado anteriormente.